

# PicoScope<sup>®</sup> 3000Eシリーズ

最大500 MHz、5 GS/s、USB給電PCオシロスコープおよびMSO  
パワーと性能を兼ね備えたポータブル



5 GS/sで100, 200, 350 MHzまたは500 MHz  
最大10ビット分解能 (拡張分解能使用で14ビット)  
2 GSの超ロングメモリ  
16チャンネルのデジタル入力 (MSOモデル)  
ファンクションジェネレーター / 任意波形発生器を標準装備  
コンパクト、ポータブル、USBバスパワー給電  
40以上のシリアルデコーダを標準装備  
セグメント・メモリ、パーシスタンス、高速波形更新  
高度な波形演算、測定、マスクおよびデジタルトリガー  
Windows<sup>®</sup>、Mac<sup>®</sup> & Linux<sup>®</sup>用 PicoScope 7 (アップデート無償)  
LabView<sup>®</sup>、MATLAB<sup>®</sup>、およびコード作成用SDK  
5年保証、無料のテクニカルサポート

## 製品概要

PicoScope 3000E シリーズは、コンパクトでポータブルな USB給電のパッケージで、最大 500 MHz の帯域幅と 5 GS/s を備えた 新世代のPC ベースのオシロスコープです。

PicoScope 3000E シリーズは、小型軽量コンパクトで持ち運びやすく、実験室か出先かを問わず、高度なエレクトロニクスや多様な組み込みシステムに取り組むエンジニアに最適な高性能仕様を備えています。100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz の周波数帯域オプションから選択できる4つのアナログチャンネル、MSOモデルでは、16のデジタルチャンネルを備えているため、あらゆるアプリケーションと予算に適したモデルが見つかります。

高度なPicoScope 7 T&Mソフトウェアにより、PicoScope 3000Eシリーズは、複雑なアナログやパワーエレクトロニクス設計のデバッグや性能検証をコスト効率よく高速に実行できます。埋め込みシステム設計、研究、試験、教育、整備サービスおよび修理といったさまざまな用途にも最適なパッケージです。

### 高帯域幅、高速サンプリング速度、大容量メモリ

コンパクトなサイズで低コストながら、入力帯域幅は最大500 MHzで性能にはわずかな妥協もありません。この広範な帯域幅に加えて、リアルタイムのサンプリング速度は最大5 GS/sで、高周波信号情報を詳細に表示できます。

他の多くのオシロスコープは最大サンプリング速度は高くても、大容量メモリがないため、この速度を長時間維持できません。PicoScope 3000Eシリーズでは、最大2 GSのキャプチャメモリを備えており、500 MHz PicoScope 3418Eでは5 GS/sから20 ms/div(最大キャプチャ時間は200 ms)までのサンプリングが可能です。

PicoScope 3000Eシリーズには幅広い範囲の強力なツールが搭載されているため、この膨大な波形メモリを最大限に活かすことができます。簡単に使用可能なズーム機能により、マウスかタッチスクリーンでドラッグするだけで、ディスプレイの縮小拡大や位置変更が行えます。SuperSpeed USB 3.0インターフェースおよびハードウェアアクセラレーション機能により、滑らかで高反応の表示が可能で、膨大な波形内のグリッチを確認できます。

メモリセグメント化により、素早く連続して何千もの波形を取得して波形バッファナビゲータに表示し、マスクリミット試験や測定リミットなどの条件を使ってフィルタリングし、確認が必要な波形を詳しく調べることができます。シリアルデコードやDeepMeasure™などの高度なツールにより、大容量メモリ内の波形バッファすべてのデータパケットやイベントを分析できるため、PicoScope 3000Eシリーズは市販されているオシロスコープの中でも非常に有用なツールとなります。



## PicoScope 3000Eシリーズの入力、出力、インジケータ

### 前面パネル



### 背面パネル



## チャンネルをトレースする色付きインジケータ

- 各BNC入力チャンネルの隣にある色付きインジケータは、画面上に表示されるトレースカラーをカスタマイズすると自動で適用され、チャンネルを識別できるため、ミスなく波形を解釈できます。



## SuperSpeed® USB-C®接続

- PicoScope 3000Eシリーズは、ホストコンピュータにUSB-C SuperSpeed接続が行えるため、1つのUSB-Cケーブルで波形の超高速保存とスコープへの電源供給が可能です。旧USB標準にも対応できるよう、USB-A から USB-Cへの変換ケーブルが同梱されていますが、USB-Aの接続ではスコープの電源要件を完全に満たすことはできないためにACアダプタが同梱されています。
- PicoSDK®は、300 MS/s以上のレートでのホストコンピュータへの連続USBストリーミングに対応しています。
- USB接続により、高速データ取得・転送が可能になるのみならず、現場からのデータの印刷、コピー、保存、メール送信を素早く簡単に行うことができます。

## シグナル・インテグリティおよび品質

ほとんどのオシロスコープは、低価格を目標として設計されていますが、一方、PicoScopesは性能向上を目指す設計になっています。繊細かつ慎重なフロントエンド設計とシールドディングにより、ノイズ、クロストーク、高調波ひずみなどを減少させることができます。

改善された帯域幅フラットネス、50 dBc SFDR、小さいひずみ、フル帯域幅で500:1以上というチャンネル間アイソレーション比などの性能を備えたPicoScope 3000Eシリーズには、オシロスコープの設計に取り組んできた長年の経験が活かされています。他のオシロスコープメーカーでは、これらの性能を達成もしくは仕様に記載することができないため、PicoTechnologyのオシロスコープの性能が他を寄せ付けないものであることは明らかです。

分解能、高い精度、再現性を達成するため、PicoScope 3000Eでもソフトウェアでも、サンプルデータの処理すべては使用しているADC分解能モードに関わりなく16ビットで実行されます。つまり、演算チャンネル、補間、フィルタリング、分解能拡張などの機能を使用して、信号の詳細な情報を実際に確認できるということです。

当社は、製品の優れた性能に自信を持っており、それら性能の詳細を公開しています。実際、回路にプローブを接続し、画面上の波形を信頼していただくことだけです。

PicoScope 3000Eシリーズ:他にはない性能で5年保証付きです。




## 低レベル信号向けの高分解能

8~14ビット分解能(分解能拡張機能使用時)のPicoScope 3000Eは、低レベル信号を高いズーム倍率で表示することができます。これにより、画像からも分かる通り、大きなDC電圧または低周波電圧に重なり合うノイズやリップルなどを表示して測定することができます。画像は、14ビット分解能拡張による、1 kHz矩形波に重畳する100 kHz正弦波です。レベル比が50倍である信号のリップルであるにもかかわらず、PicoScope 3000Eに搭載される高分解能および大容量メモリにより、詳細まで拡大して確認・測定できます。

機器自体のハードウェア帯域幅フィルター上で強力なソフトウェアフィルター(ローパス、ハイパス、バンドパス、ハンドストップ)や分解能拡張を使用すると、信号の詳細をさらに表示できます。PicoScope 3000Eシリーズは、他のスコープに比べて多様なハードウェア帯域幅フィルターを搭載していますが、アナログやデジタルフィルター両方を利用することで、ノイズを低減させてさらに効果性を高めることが可能です。

PicoScope 3000Eシリーズを使用すれば、幅広いハードウェアフィルター、ソフトウェアフィルターおよび10ビット分解能をさらに高める分解能拡張機能により、信号の詳細をくまなく確認できます。



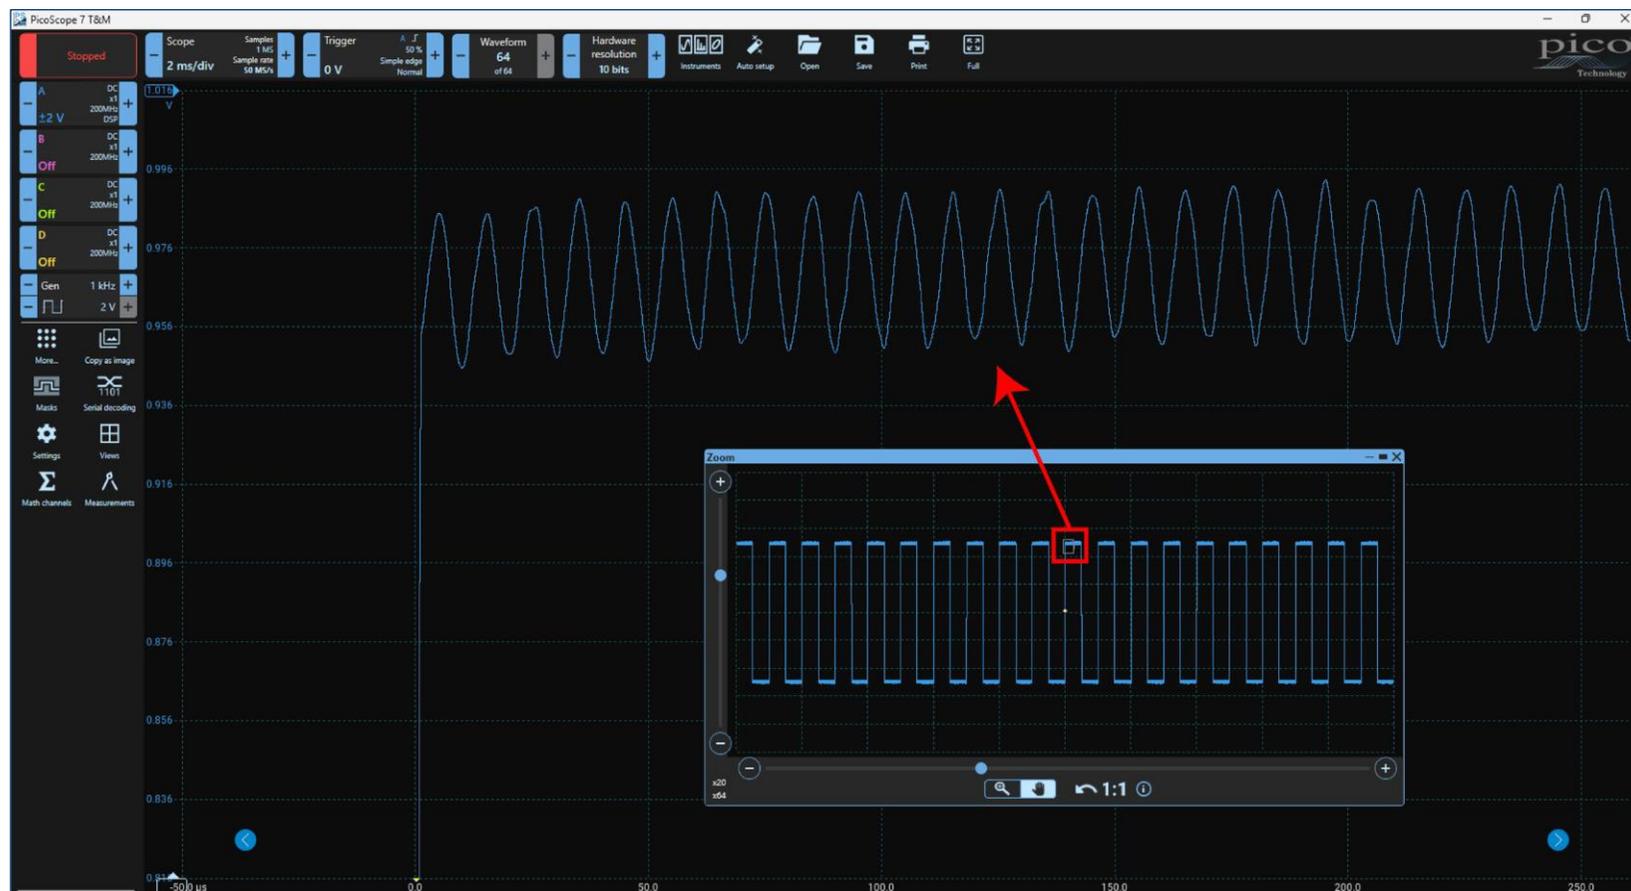


14ビット分解能拡張機能を使用した、1 kHz矩形波の100 kHzリップル

## FFTスペクトラムアナライザ

スペクトルビューでは、周波数に対する振幅をプロットします。信号のノイズ、クロストーク、ひずみなどを見つけるのに最適です。PicoScopeのスペクトラムアナライザは、高速フーリエ変換(FFT)方式で、従来の掃引方式のスペクトラムアナライザとは異なり、単発の不連続波形のスペクトラムを表示する機能があります。PicoScopeのFFTは最大100万のポイントを有しており、非常に優れた周波数分解能と低いノイズフロアが特徴です。

ボタンをクリックすると、アクティブなチャンネルのスペクトルプロットが表示されます。最大周波数は、お使いのスクープの帯域幅となります。複数のスペクトルビューを表示し、これらと同じデータのオシロスコープビューと共に表示することができます。THD、THD+N、SNR、SINAD、IMDなど、自動周波数領域測定機能をディスプレイに追加できます。マスキング試験をスペクトルに適用したり、AWGとスペクトルモードを一緒に使用して掃引スカラーネットワーク解析を実行することも可能です。

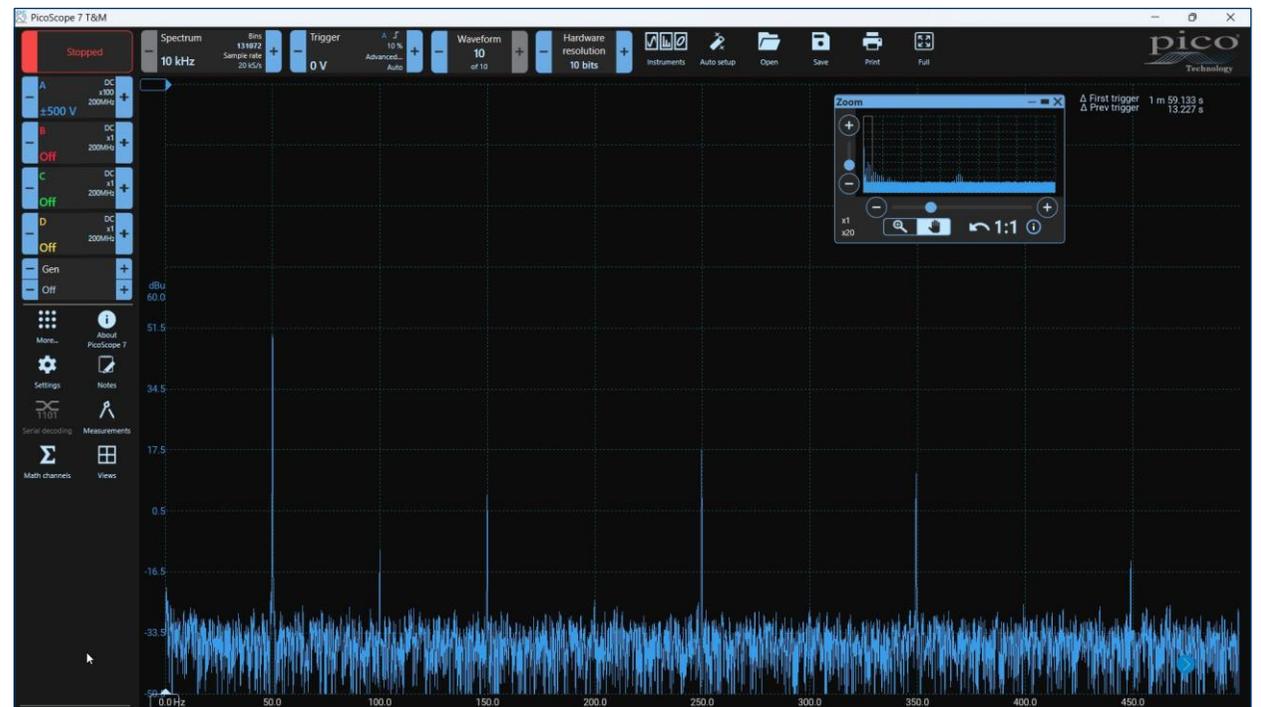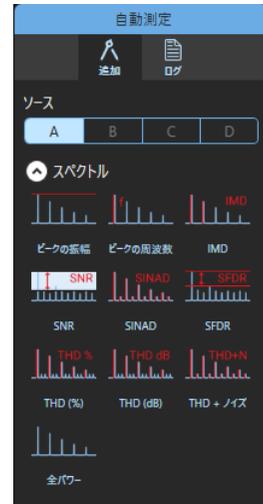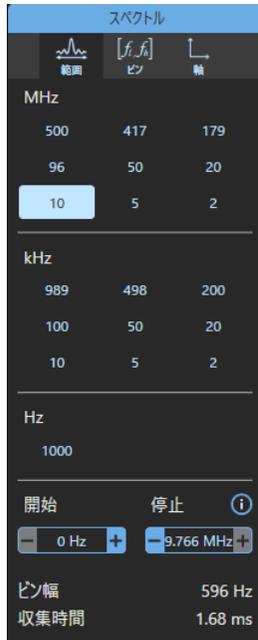


豊富な設定項目により、スペクトル帯(FFTビン)、スケール(リニア/log)、ディスプレイモード(通常、平均、ピークホールド)などを制御することができます。窓関数を簡単に選択できるので、周波数選択性、精度、ダイナミックレンジを最適化できます。

## 任意波形およびファンクションジェネレーター

すべてのPicoScope 3000Eモデルには、周波数範囲が100  $\mu$ Hz~20 MHzのファンクションジェネレータが搭載されています。レベル、オフセット、周波数の設定など、基本的な制御に加え、さらに詳細な制御を行うことができるため、様々な周波数に対応させることができます。スペクトルピークホールドオプションと使用すると、アンプやフィルター応答の試験を行う強力なツールとなります。

トリガーツールにより、スコープトリガー、マスクリミット試験失敗、AUX入力のトリガイベントなど、様々な条件を満たす場合に、波形の1つ、またはそれ以上のサイクルを出力することができます。


すべてのモデルには、14ビット200 MS/s任意波形ジェネレーター(AWG)も搭載されています。AWG波形は、内蔵のエディターで作成・編集したり、オシロスコープトレースからインポートしたり、スプレッドシートから読み込んだり、CSVファイルにエクスポートしたりすることができます。

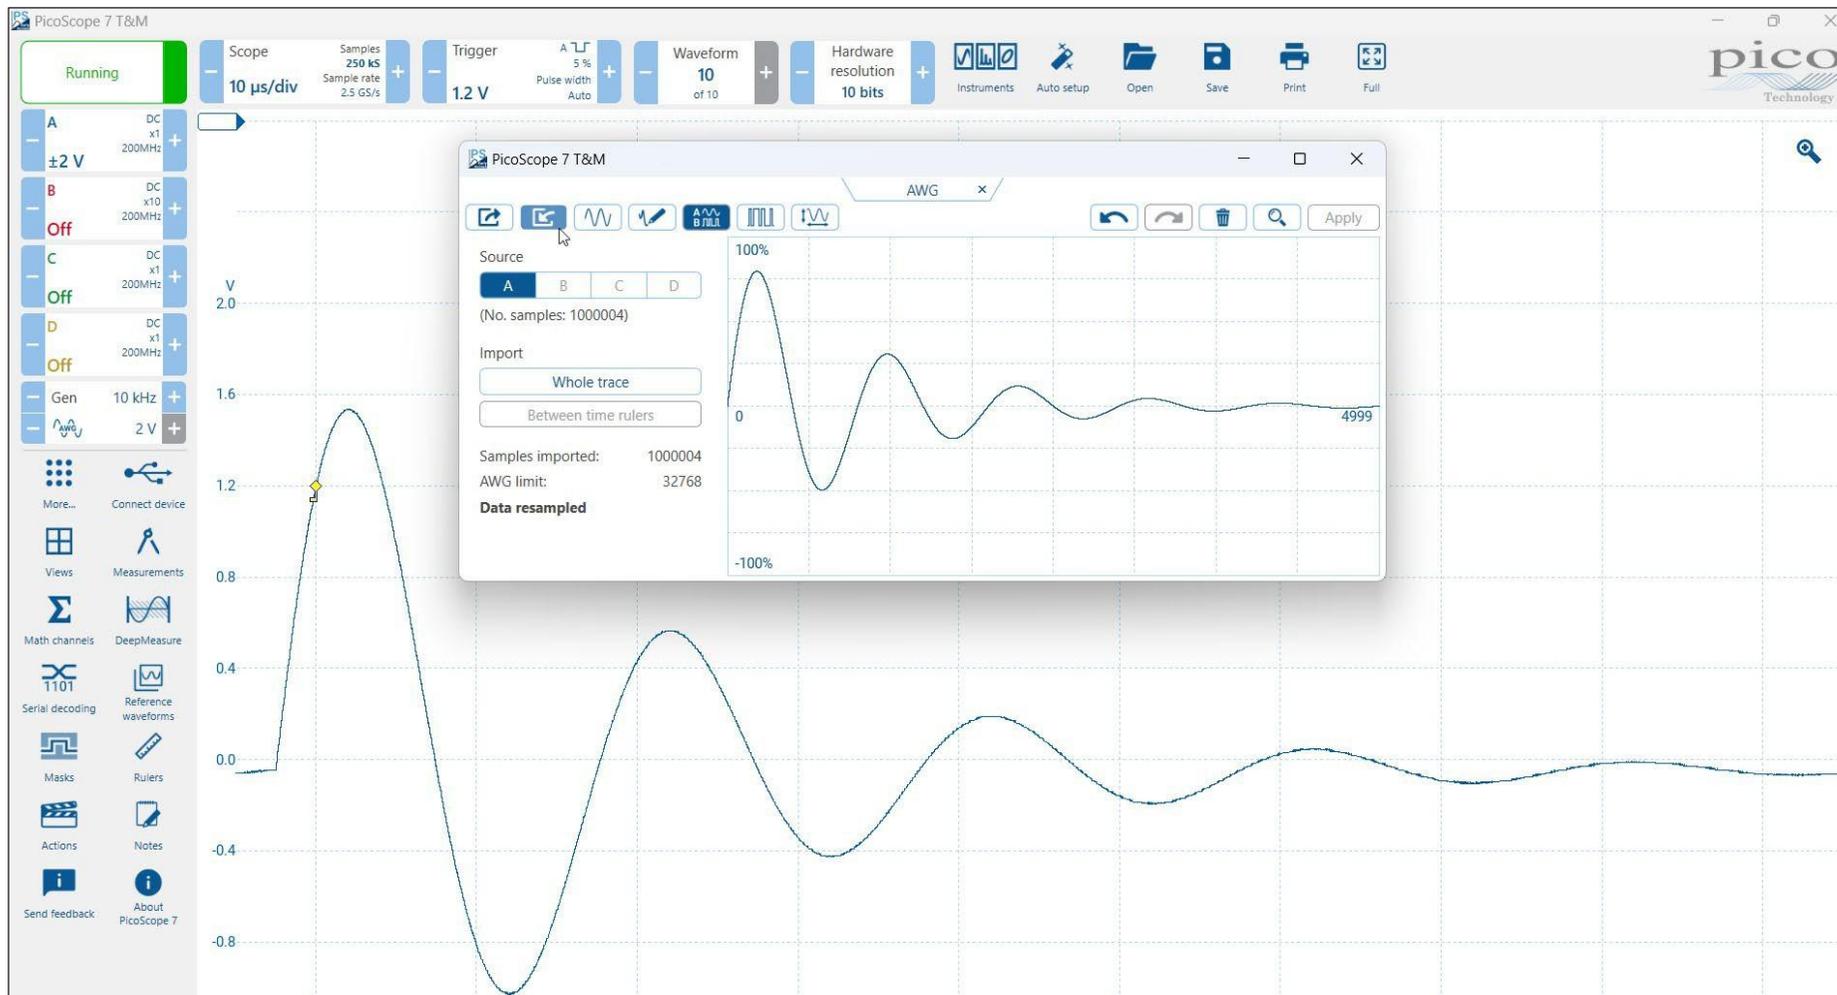

## デジタルトリガーアーキテクチャ

多くのデジタルオシロスコープには、アナログコンパレータに基づくトリガーアーキテクチャが未だに使用されています。この場合、必ずしも修正できるとは限らない時間および振幅エラーが発生する場合があります、高帯域幅でのトリガー感度も制限されてしまいます。

1991年に、Picoは実際のデジタル化データを使用した完全デジタルトリガーを世界に先駆けて開発しました。この技術はトリガーエラーを減少させることができ、小さい信号でもオシロスコープをトリガーすることができます。全帯域幅であっても可能です。トリガーレベルおよびヒステリシスは、高い精度および分解能で設定することができます。

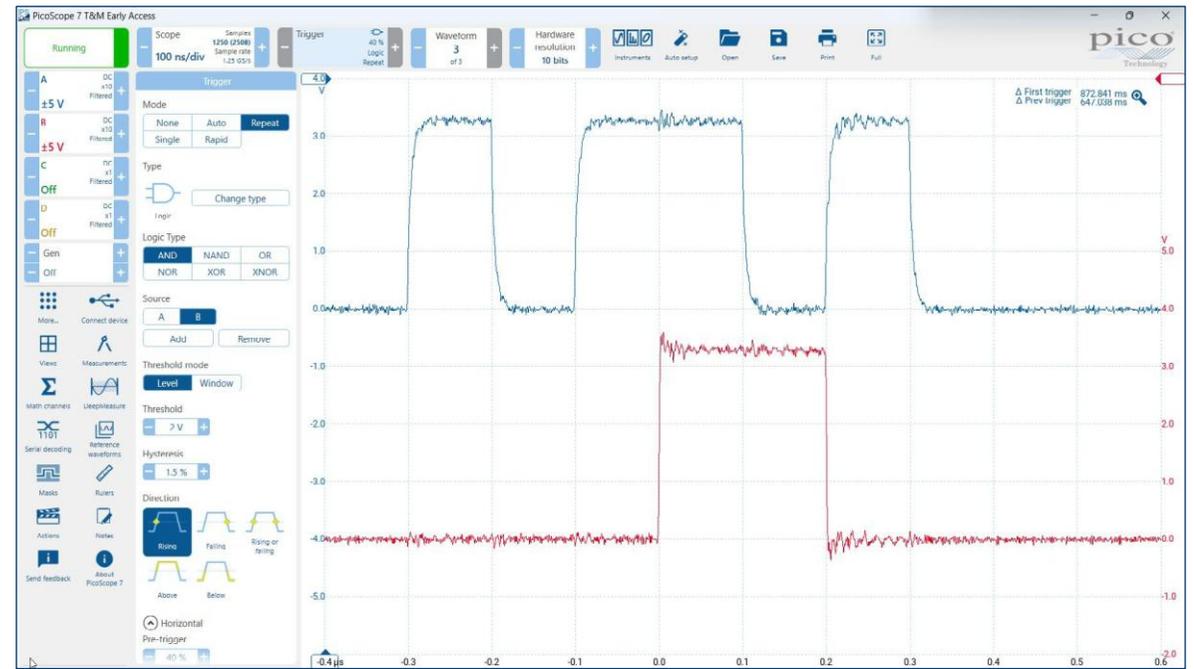

## 高度なトリガー

PicoScope 3000Eシリーズは、パルス幅、ラントパルス、ウィンドウ化、立ち上がり/立ち下がり時間、ロジック、ドロップアウトなど、スコープ帯域幅をフルに活用できる高度なトリガーを提供します。

パルス幅トリガーには、正または負のパルスのどちらでトリガーするか方向コントロールがあります。レベル/ウィンドウ損失トリガーでは、信号がしきい値に対して高い状態、低い状態、またはその両方の状態のいずれのドロップアウト状態でトリガーするかを指定できます。

MSOモデルで使用可能なデジタルトリガーにより、16個のデジタル入力のいずれか、またはすべてがユーザー定義したパターンと一致する場合、スコープをトリガーすることができます。各チャンネルごとに別個に条件を指定したり、16進法値または2進法値を使ってすべてのチャンネルに一度にパターンを設定したりできます。


ロジックトリガー機能により、アナログ入力のエッジまたはウィンドウトリガーの組み合わせでトリガーすることができます。例えば、チャンネルBも高い場合にチャンネルAのみのエッジでトリガーしたり、4つのチャンネルのいずれかが指定した電圧範囲を超えた場合にトリガーしたりできます。

### パルスの方向

正 負 両エッジ

### ドロップアウト

高 低 両エッジ

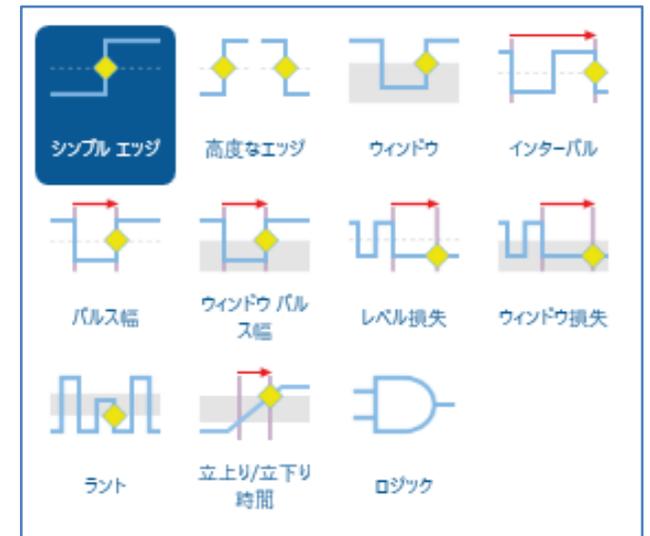


拡張トリガ機能

## トリガーホールドオフ


トリガーホールドオフは、トリガーによる取得後の遅延期間を設定する調整です。この期間、オシロスコープは再びトリガーを行うことはできません。

複雑な波形のトリガーの信頼性や再現性を高めるのは非常に難しい場合があります。例えば、パルスのバーストを確認する際、標準のエッジトリガーは、バースト内の立ち上がりエッジで作動してしまう場合があります。これにより、波形が重なってちらついた表示となってしまう、表示するのが難しく、試験中の装置の動作という点では意味がなくなってしまいます。

トリガーホールドオフにより、トリガーによる各取得後にスコープがトリガーイベントを検出しない期間を設定できるため、取得間のオシロスコープの不感時間を効果的に延長できます。ホールドオフ時間をパルスレイン長以上に長くすることにより、以下のようにオシロスコープが正しくトリガーを実行できるようにします。

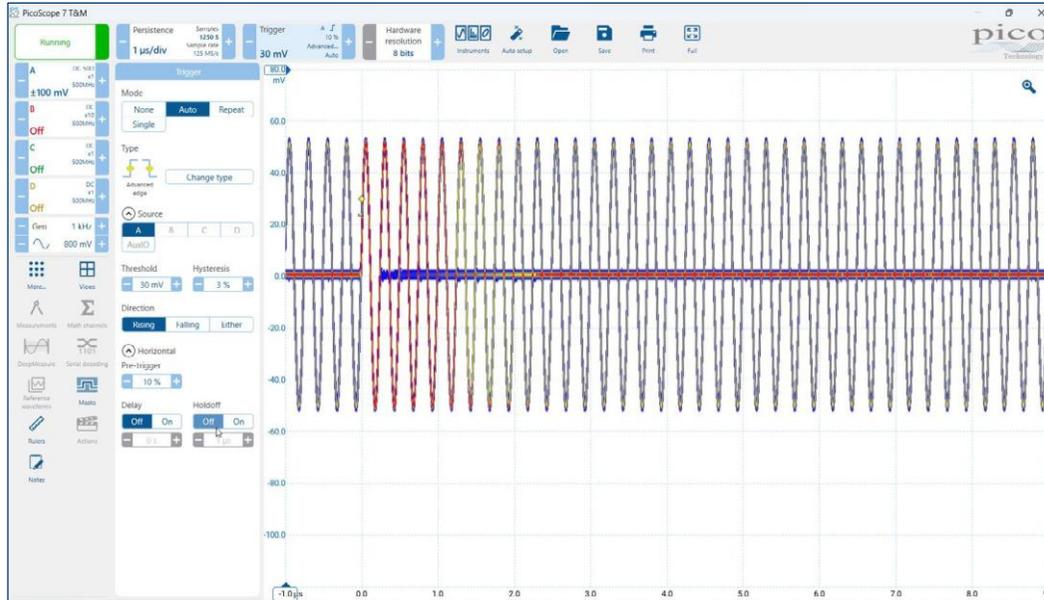

トリガーホールドオフなしの場合、オシロスコープはバーストのダウンストリームパルスで誤ってトリガーを実行。

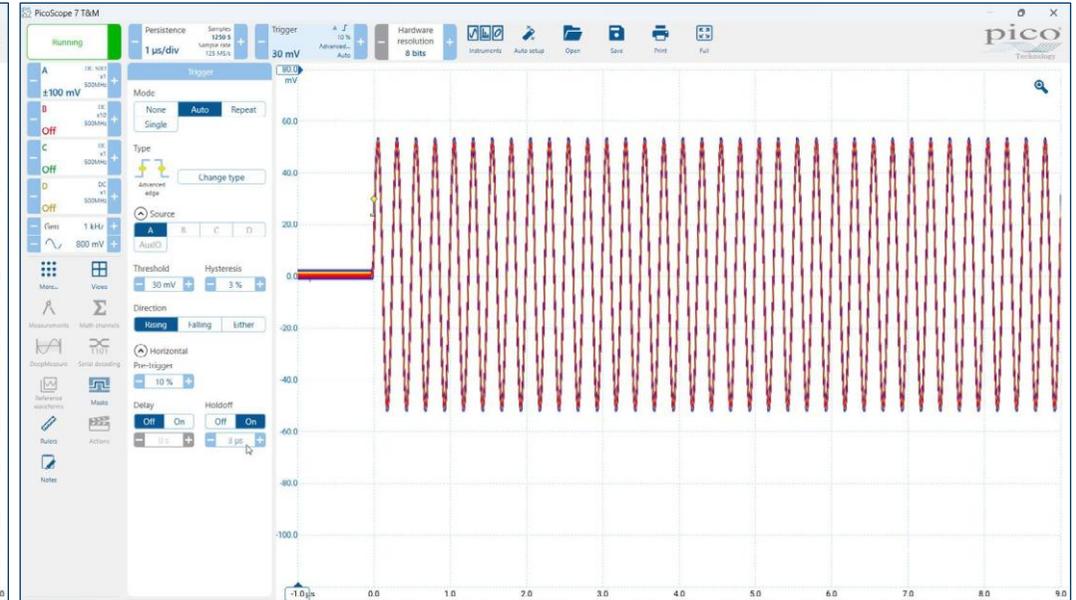

適切なトリガーホールドオフ設定により、オシロスコープはバーストの最初のパルスでのみ正しくトリガーを実行。


## パーシスタンスモード

PicoScopeのパーシスタンスモードオプションを使うと、古いデータと新しいデータを重ねて表示することができるため、グリッチやドロップアウトを簡単に見つけて、その相対頻度を推測することができます。ビデオ波形やアナログ変調信号など、複雑なアナログ信号の表示、解釈に便利です。色分けや強度グレーディングにより、安定したエリアや間欠的なエリアを見分けることができます。高速、時間および頻度からパーシスタンス・タイプが選択でき、カスタマイズすることができます。

オシロスコープの性能(特にパーシスタンスモード)を評価する上で重要な仕様となるのは、波形の更新レートです。更新レートは1秒ごとの波形数で表されます。サンプリング速度はオシロスコープが1つの波形またはサイクル内の入力信号をサンプリングする頻度を示しますが、波形更新レートはオシロスコープが波形を取得する速さを表します。

波形更新レートが高いオシロスコープは、信号の動作に関する情報をより詳細に視覚的に表示できます。また、ジッター、ラントパルス、グリッチなどの過渡異常を、それらの問題の存在に気付く前にオシロスコープで素早く検出する確率も劇的に高めることができます。

PicoScope 3000EシリーズのHAL4ハードウェアアクセラレーションは、高速パーシスタンスモードで1秒間に300,000波形の連続更新レートを達成することができます。

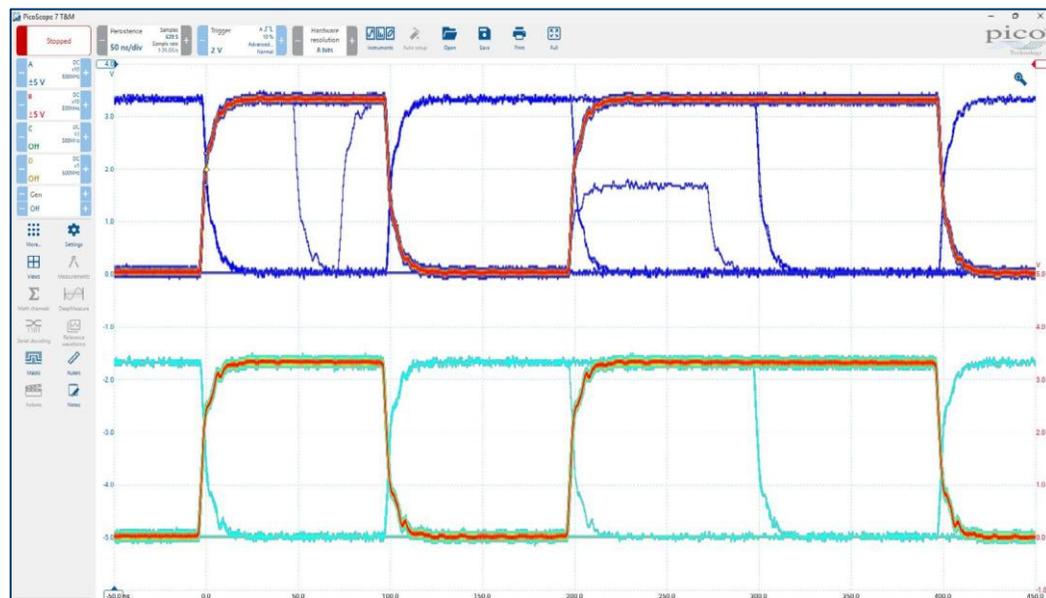

## 超大容量メモリ

PicoScope 3000Eシリーズオシロスコープの波形取込みメモリは、最大2Gサンプルで、競合他社のスコープより何倍も大きいメモリを搭載しています。ディープメモリにより、最大サンプル速度で長時間の波形を取り込むことができます。実際、PicoScope 3000Eシリーズは、200 psの分解能で200 msの波形を取得することができます。


パケット間の間隔が長い高速のシリアルデータ、またはミリ秒間隔のナノ秒レーザーパルスなどを観測する場合、この大容量メモリは非常に貴重な機能となります。

取込みメモリを最大40,000までセグメント化することができるため、他にも様々な状況で、PicoScopeをお役立ていただくことができます。トリガー条件を設定して、各セグメントに別のキャプチャを保存し、キャプチャ間のロス時間を700 nsにまで小さくすることができます。

高速トリガーモードでは、20 msで40,000の波形を取得できます。これは1秒間に**200万波形**という効果的な取込みレートになります。

データを取り込んだら、1つのセグメントずつ確かめて、探しているイベントを簡単に確認できます。

強力なツールにより、これらデータすべてを管理・解析することができます。マスキリミット試験やDeepMeasureなどの機能により、PicoScopeソフトウェアでは波形を最大100万回調べるすることができます。ズームウィンドウでは、ズーム領域のサイズや場所を簡単にコントロールすることができます。波形バッファ、シリアルデコード、ハードウェアアクセラレーションなどの他のツールを大容量メモリと併用することで、PicoScope 3000Eはコンパクトで強力なオシロスコープとなります。

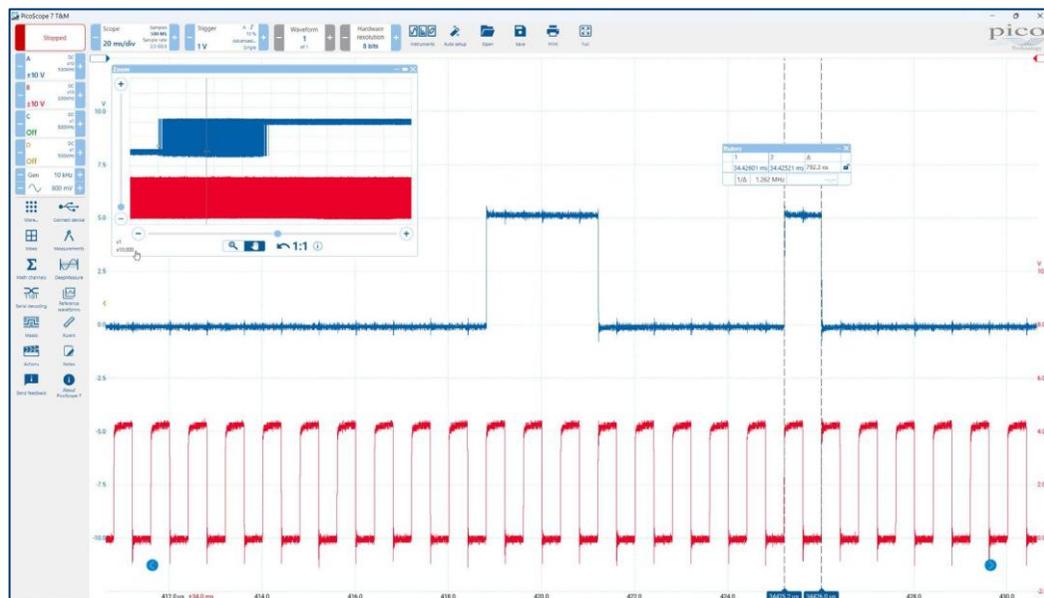

## ミックスドシグナルモデル

PicoScope 3000E MSOモデルは、16のデジタルチャンネルを追加することができるため、アナログおよびデジタル信号の正確な時間相関を得ることができます。

デジタルチャンネルは、グループ化してバスとして表示することができます。各バス値は、16進法、2進法、10進法で、またはレベルとして(DAC試験)表示されます。アナログおよびデジタルチャンネルの両方で詳細なトリガーを設定できます。

デジタル入力によって、シリアルデコードオプションはさらに強化されます。アナログおよびデジタルチャンネル上のシリアルデータを同時にデコードすることができるため、例えば、複数のSPI、I<sup>2</sup>C、CANバス、LINバス、FlexRayなどの信号のデコードを最大20チャンネルのデータに対して同時に行うことができます。



PicoScope 3000E MSO



すべてのMSOモデルには、以下のアクセサリが同梱されています。



20方向25 cmデジタルMSOケーブル



MSO試験クリップ


# DeepMeasure

1つの波形で、100万回の測定。

波形パルスやサイクルの測定は、電気・電子装置の性能検証においては非常に重要です。

DeepMeasureは、取得した波形内の個々のサイクルに関し、パルス幅、立ち上がり時間、電圧などの重要な波形パラメーターを自動で測定します。トリガーされた各波形取得または複数の取得の組み合わせには、最大100万サイクルを表示することができます。測定結果は、波形ディスプレイを使用して簡単に並べ替え、分析し、相互に関連付けることができます。また、今後の解析に備えて、CSVファイルやスプレッドシートにエクスポートすることも可能です。

例えば、DeepMeasureを使用すると、40,000のパルスを取得して最大または最小の振幅を含むパルスを素早く特定できます。また、スコープの大容量メモリを使って、1つの波形の100万サイクルを記録して、すべてのエッジの立ち上がり時間をエクスポートして統計的解析を行うことも可能です。

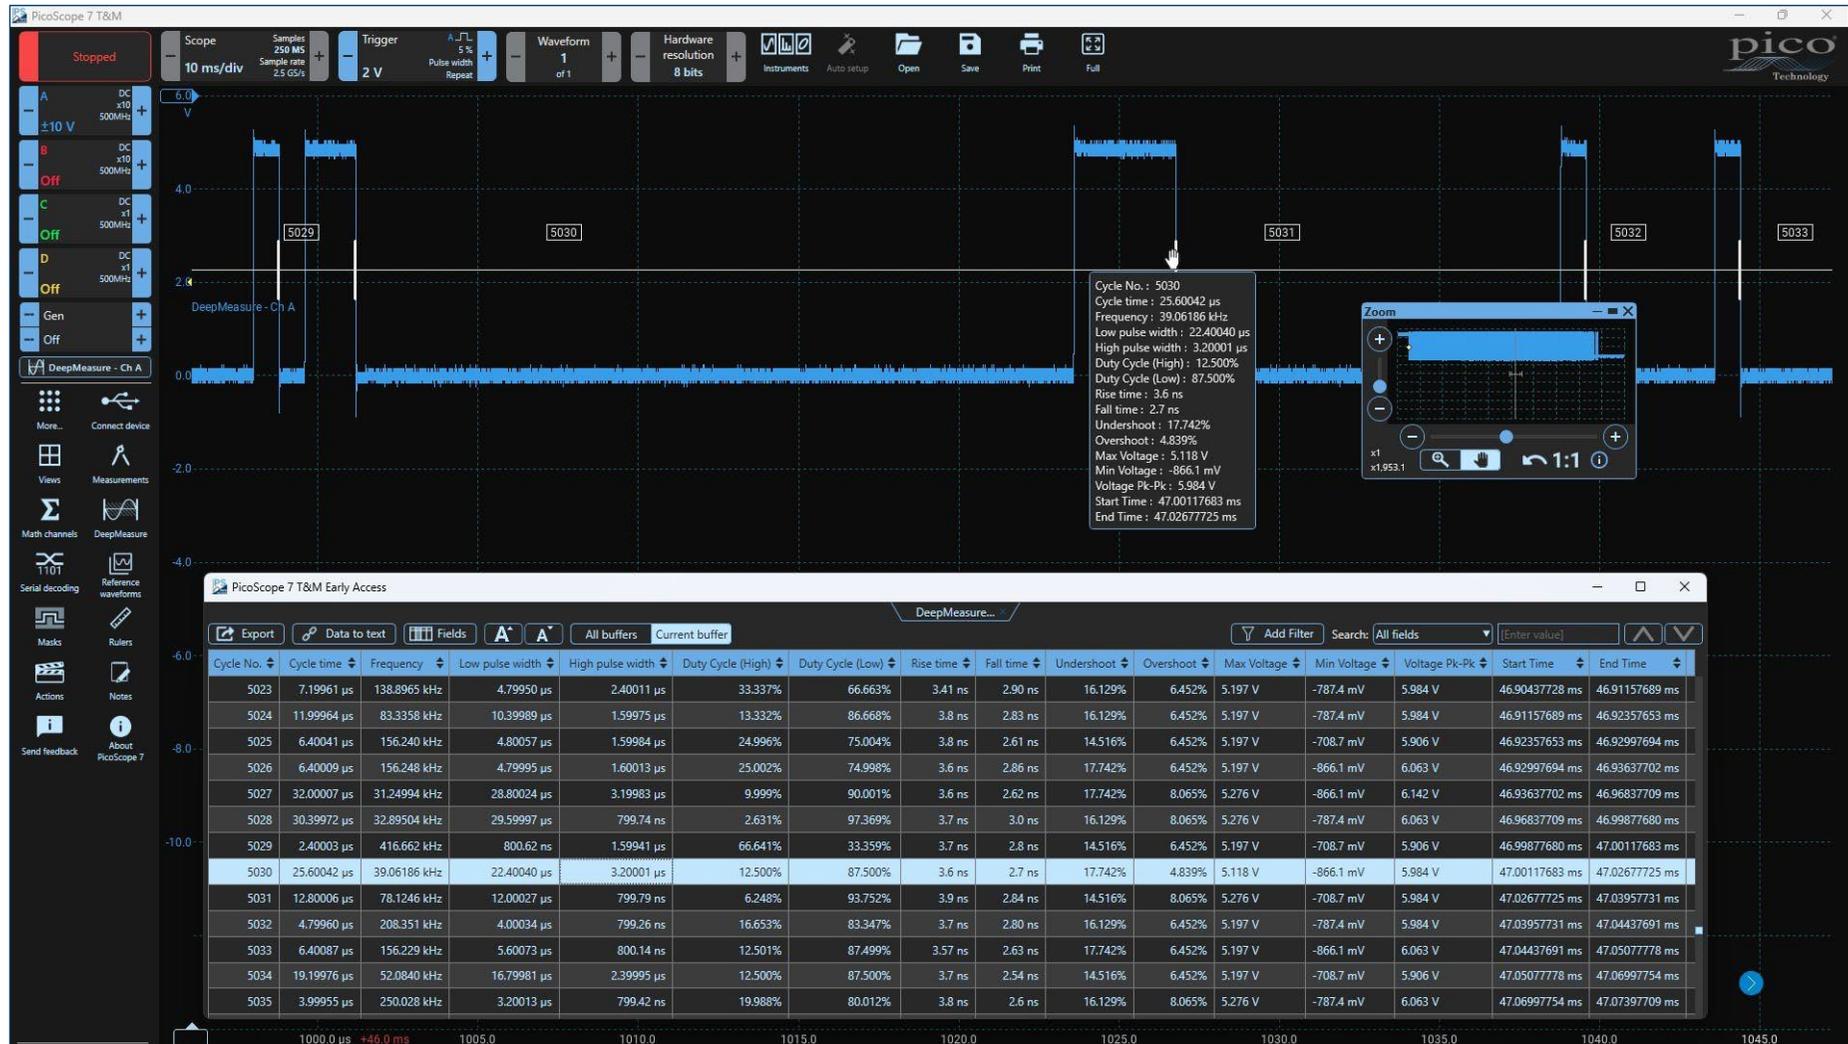


## シリアルバスデコードおよびプロトコル解析

PicoScopeは、10BASE-T1S、1-Wire、ARINC 429、BroadRReach、CAN、CAN FD、CAN J1939、CAN XL、DALI、DCC、差動マンチェスタ、DMX512、Ethernet 10BASE-T、Extended UART、Fast Ethernet 100BASE-TX、FlexRay、I2C、I2S、I3C BASIC v1.0、LIN、Manchester、MIL-STD-1553、MODBUS ASCII、MODBUS RTU、NMEA-0183、Parallel Bus、PMBus、PS/2、PSI5(センサー)、Quadrature、RS232/UART、SBS Data、SENT Fast、SENT Slow、SENT SPC、SMBus、SPI-MISO/MOSI、SPI-SDIO、USB(1.0/1.1)、風センサープロトコルデータのデコードに標準で対応しており、現在さらに多くのプロトコルを開発中です。今後、ソフトウェアのアップグレードで無料でご利用いただけるようになります。

グラフ形式では、一般の時間軸上の波形の下に、デコードしたデータ(16進法、2進法、10進法、ASCII)がデータバスタイミング形式で表示され、エラーのあるフレームは赤でマークされます。これらのフレームを拡大して、ノイズや信号品質に関する問題について調べることができます。


表形式の場合、データ、フラッグや識別しすべてを含む、デコードしたフレームのリストが表示されます。フィルター条件を設定して、関心のあるフレームのみを表示したり、特定の特性を持つフレームを探したりすることができます。統計オプションは、フレーム時間や電圧レベルなどの物理レイヤーに関する詳細を示します。表の中のフレームをクリックすると、オシロスコープの表示が拡大され、そのフレームの波形が表示されます。

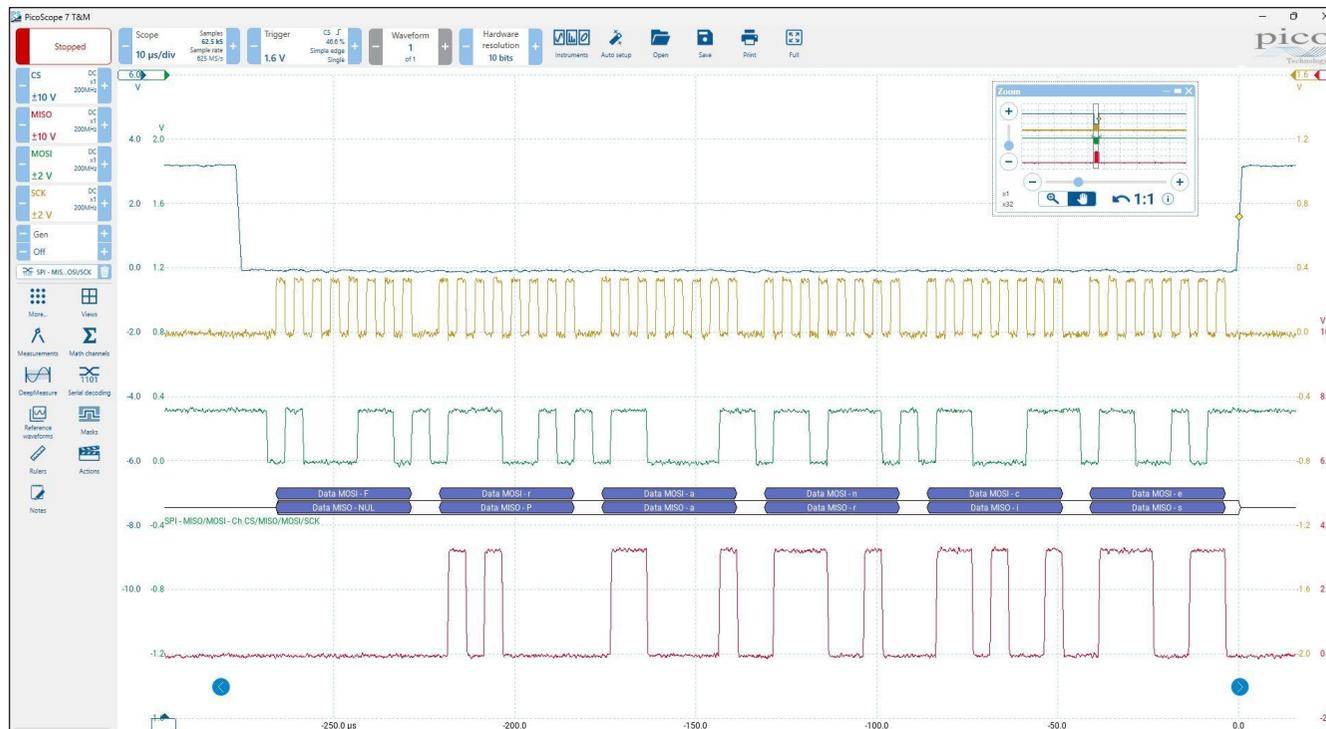

SPIプロトコル

PicoScopeは、「リンクファイル」スプレッドシートをユーザー定義のテキスト文字列にインポートして、データのデコードを行うことができます。16進法フィールド値を解釈可能な形式に相互参照することにより、解析速度を早めることができます。例えば、表ビューに「Address: 7E」を表示する代わりに、対応するテキストである「モーター速度の設定」が表示されます。フィールドヘッディングをすべて備えたリンクファイルテンプレートは、シリアル表ツールバーから直接作成することができ、スプレッドシートとして手動で編集して、相互参照値を適用することができます。

MSOモデルでは、アナログ・デジタルの両方のチャンネルを使って、シリアルデータの最大20チャンネルのデコードを行うことができるため、複数のバスを同時に柔軟にデコードすることが可能です。

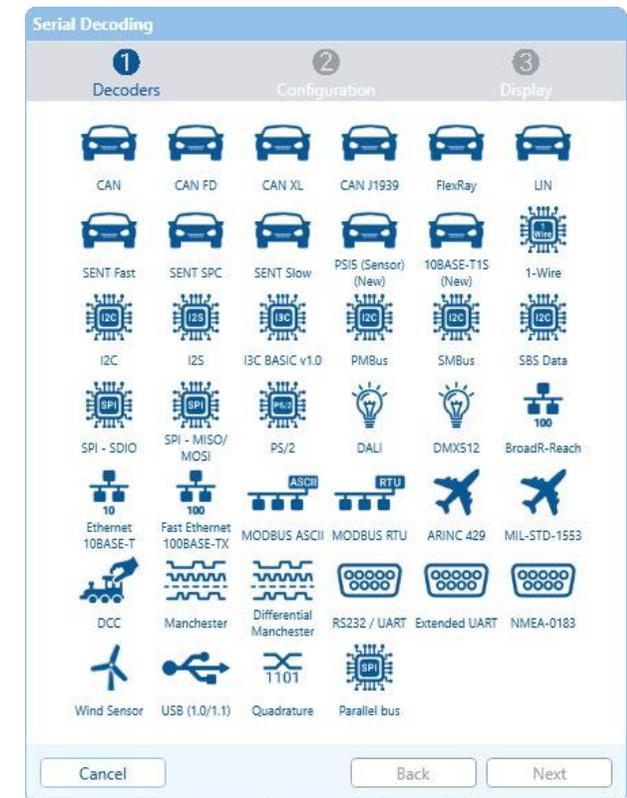

40種類のシリアル・プロトコル・デコーダー 追加開発中

## マスクリミット試験

マスクリミット試験では、ライブ信号と既存の安定した信号を比較することができ、製造およびデバッグ環境で使用するために設計されています。既知の安定した信号をキャプチャし、その信号を使用してマスクを自動生成し、試験中のシステムを測定します。


PicoScopeは、マスク違反を確認して合否テストを実行し、間欠的なグリッチを捕捉します。不合格カウントや他の統計は [測定] ウィンドウに表示できます。マスクは、後で使用できるようにライブラリに保存したり、エクスポートまたはインポートして他のPicoScopeユーザーと共有したりすることができます。

## 波形バッファおよびナビゲーター

波形にグリッチを見つけても、スコープを止める時にはもうなくなっている、ということがありませんか？PicoScopeを使えば、グリッチや他の過渡イベントを見逃す心配はなくなります。PicoScopeは、環状波形バッファ内に最後の40,000オシロスコープ波形またはスペクトラム波形を保存することができます。

バッファナビゲーターにより、波形を効率的にナビゲートして検索できるため、効果的に時間を遡ることができます。マスクリミット試験などのようなツールを使い、バッファ内の各波形をスキャンしてマスク違反を特定することができます。

波形バッファも急速トリガーモードで使用できます。この場合、スコープはたった20 msで40,000波形バッファを貯めることができます(1秒間に200万波形)。マスクリミット試験、DeepMeasure、シリアルバスデコードなど、PicoScope 7に含まれる高度なツールを使用して、取得した波形を処理できます。

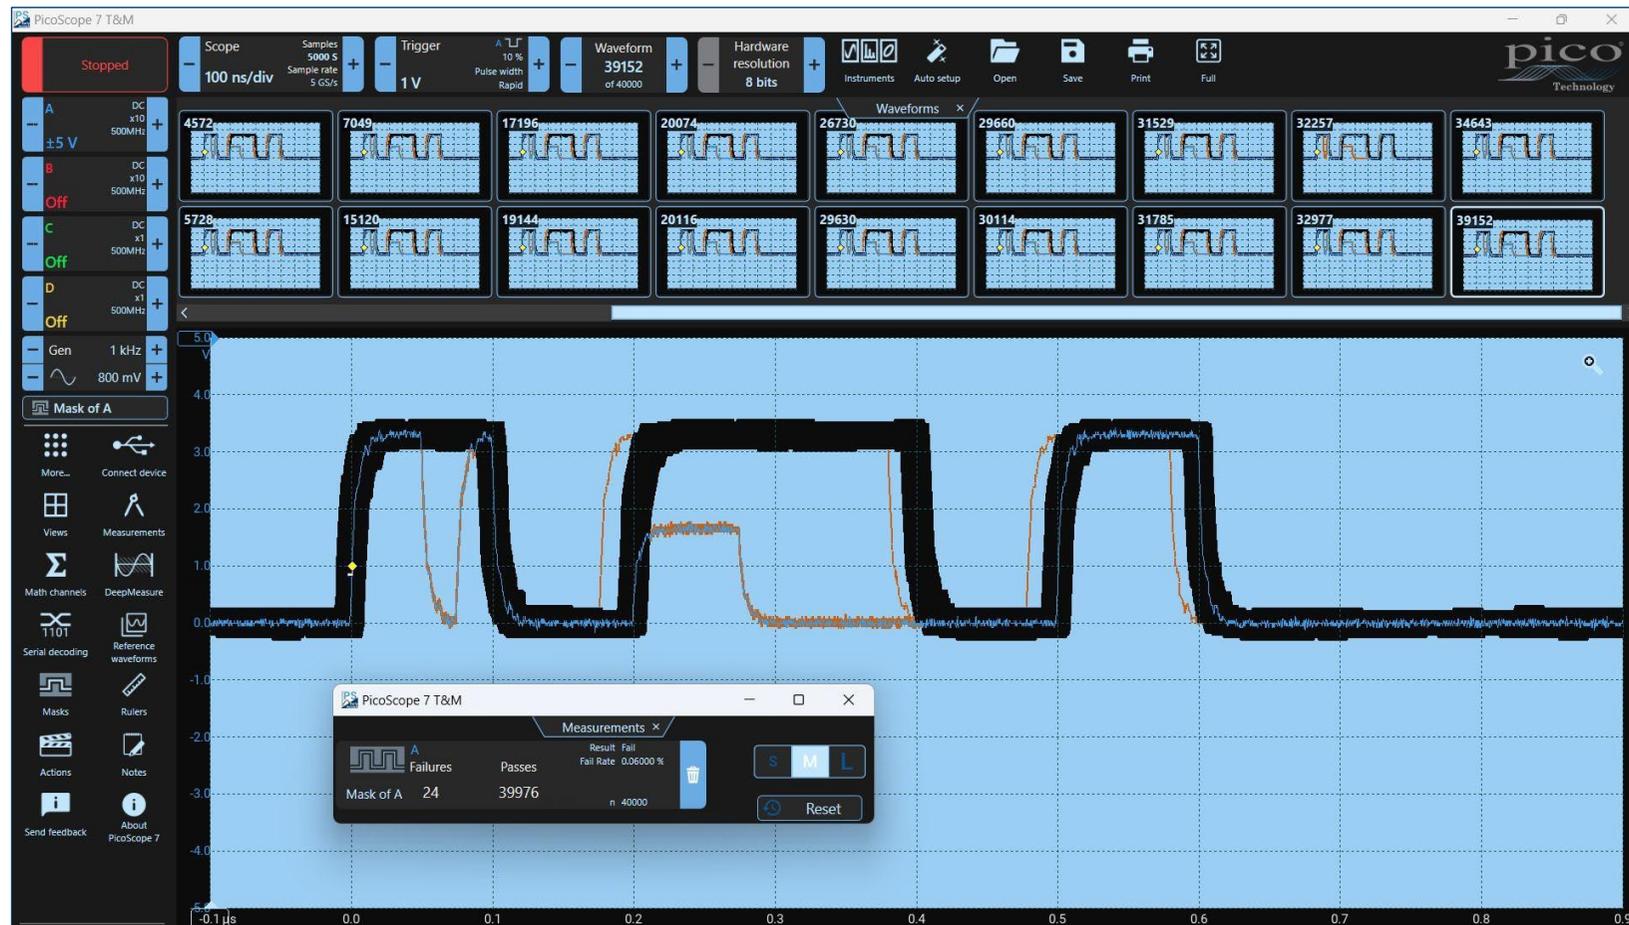


## 自動測定

PicoScope 7は、グラフに表示される波形に適用可能な、事前定義された測定を数多く搭載しています。波形特性が時間の経過と共に変化する場合、測定により、ライブ波形に基づいて現在の結果を追跡・表示することができます。統計には、試験期間の平均(中間)、最大、最小、標準偏差の値を表示できます。



ラージサイズディスプレイオプション(L)に設定されています。

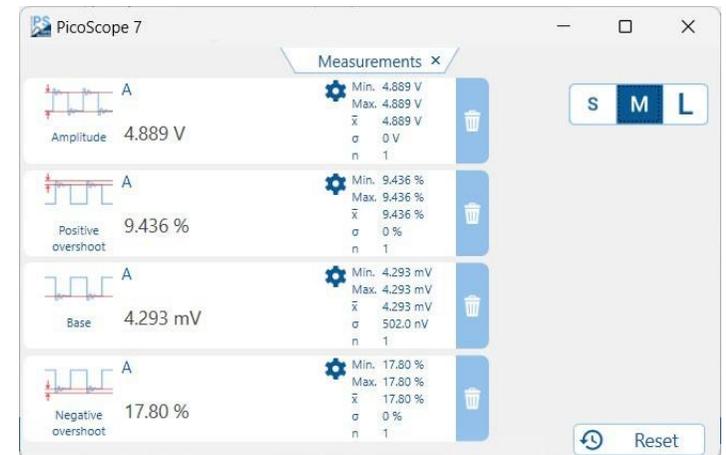

ミディアムサイズディスプレイオプション(M)に設定されており、統計情報が表示されています。

## 測定:パス/フェイル・リミット

PicoScopeソフトウェアでは、すべての自動測定結果に対し、合否判定範囲を設定することができます。これにより、測定結果が指定した値を超える、または下回る場合、測定ウィンドウ内で判定結果を視覚的に表示できます。

合否判定結果をアクションと併用することで、測定しきい値が設定した制限を超える、または下回る場合に、ユーザーに迅速に警告したり、他のアクションを実行したりできます。

波形バッファをフィルタリングして測定リミットに失敗した波形のみを表示することで、PicoScopeのロング・メモリで取得した何千もの波形から注目する波形を迅速に特定することができます。

### ピークピーク

ソース

A  B

計測する波形を選択

トレース全体  ルーラー間

合否判定の範囲

上限 (超)  オフ  オン

下限 (未滿)  オフ  オン

---

A

ピークピーク **618.4 mV**

最小 609.1 mV  
最大 813.7 mV  
平均 711.2 mV  
σ 101.2 mV  
n 2524


失敗: 744 成功: 1250

## 測定ロギング

PicoScopeにより、測定結果をファイルに記録して後で分析することができます。結果のログは、熱的効果や他の効果によるドリフトの評価など、中～長時間試験中の回路のパフォーマンスの解析に使用できます。また、電源電圧など、外部制御の変数に対する機能性の確認などにも使用可能です。

記録可能な最大行数は、ユーザー設定の制限、またはディスクの容量によって決まります。

詳細は、[測定](#)を参照してください。

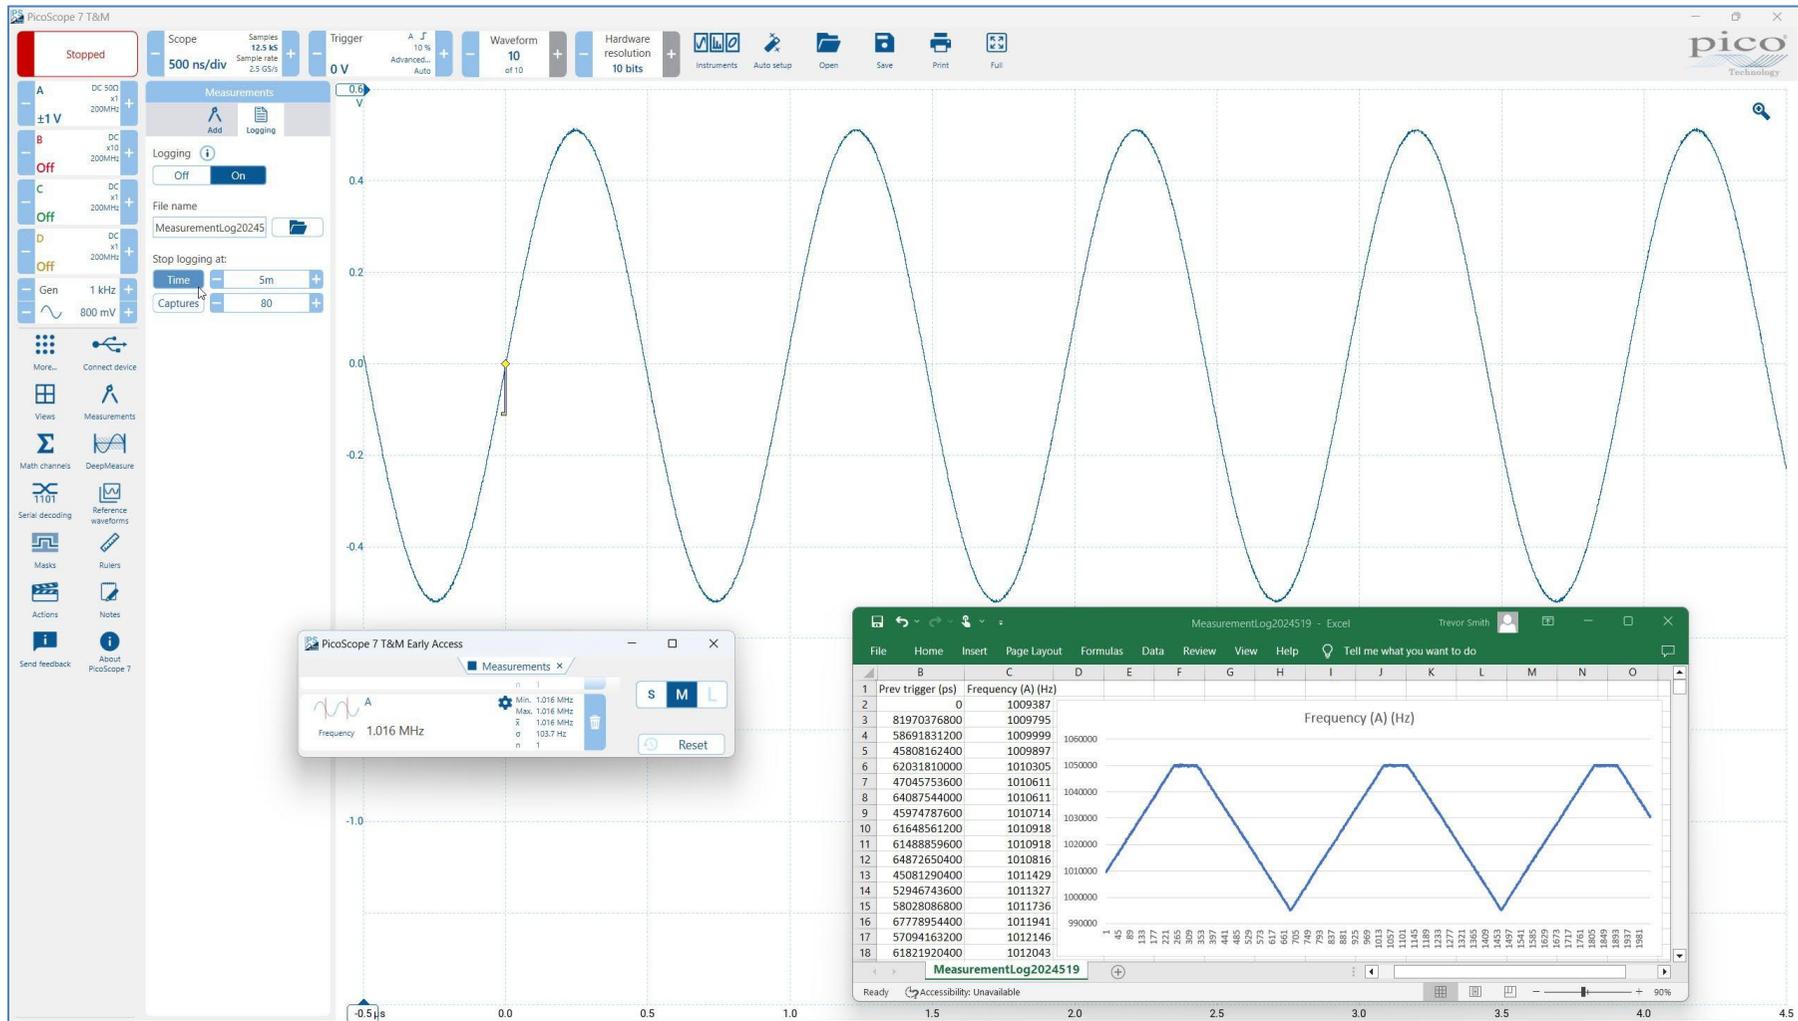


## 測定:電力

PicoScopeソフトウェアは、電力測定ツール(さらに開発中)を提供しており、以下のような関連する電力演算チャンネルも利用いただけます:

- 有効電力
- 皮相電力
- 無効電力
- 力率
- DC電源
- 波高率(クレストファクター)
- ACエリア
- AC+エリア
- AC-エリア
- AC絶対エリア
- DCエリア
- DC+エリア
- DC-エリア
- DC絶対エリア

PicoScopeでは、演算チャンネルを使用して電力測定結果をグラフに表示したり、測定オプションを使って画面上に一連の値や統計を表示したりすることができます。

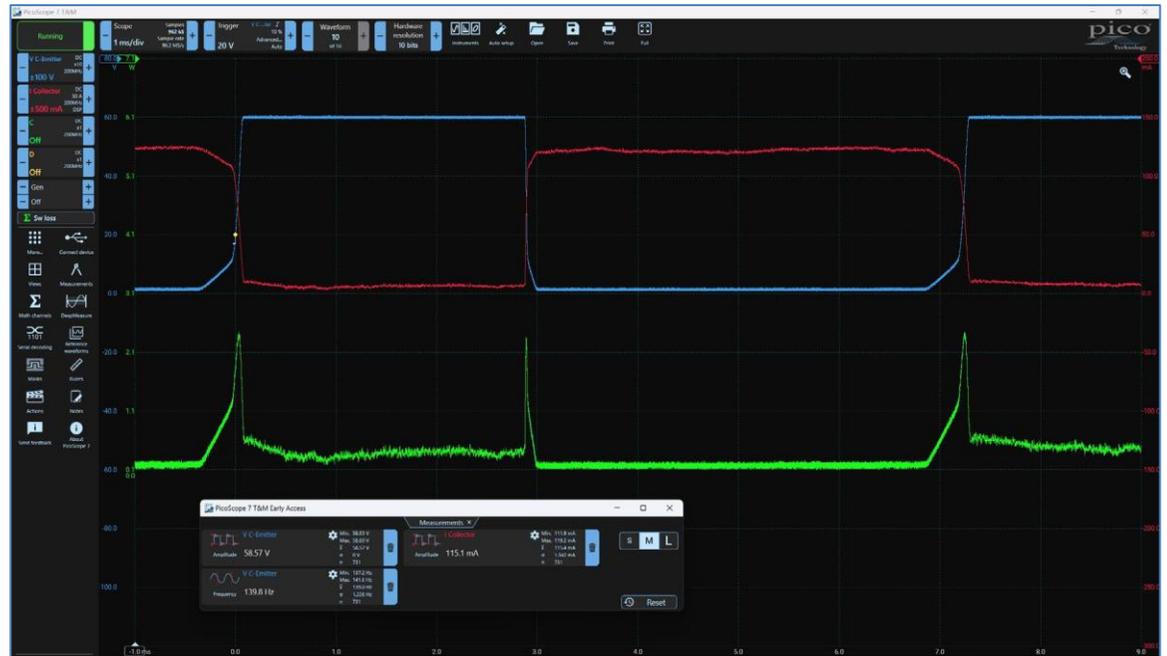

IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)スイッチロス測定

**有効電力**

電圧

A	B	C	D
---	---	---	---

電流

A	B	C	D
---	---	---	---

計測する波形を選択

トレース全体	ルーラー間
ルーラー 1 のサイクル	ルーラー 2 のサイクル
トリガー点のサイクル	

閾値

自動  信号ルーラーを使用

ヒステリシス

- 1.5% +

合否判定の範囲


上限 (超)      下限 (未満)

オフ   オン	オフ   オン
---------	---------

- 0 W +      - 0 W +

失敗時の操作      失敗した波形を表示

有効電力 設定ウィンドウ

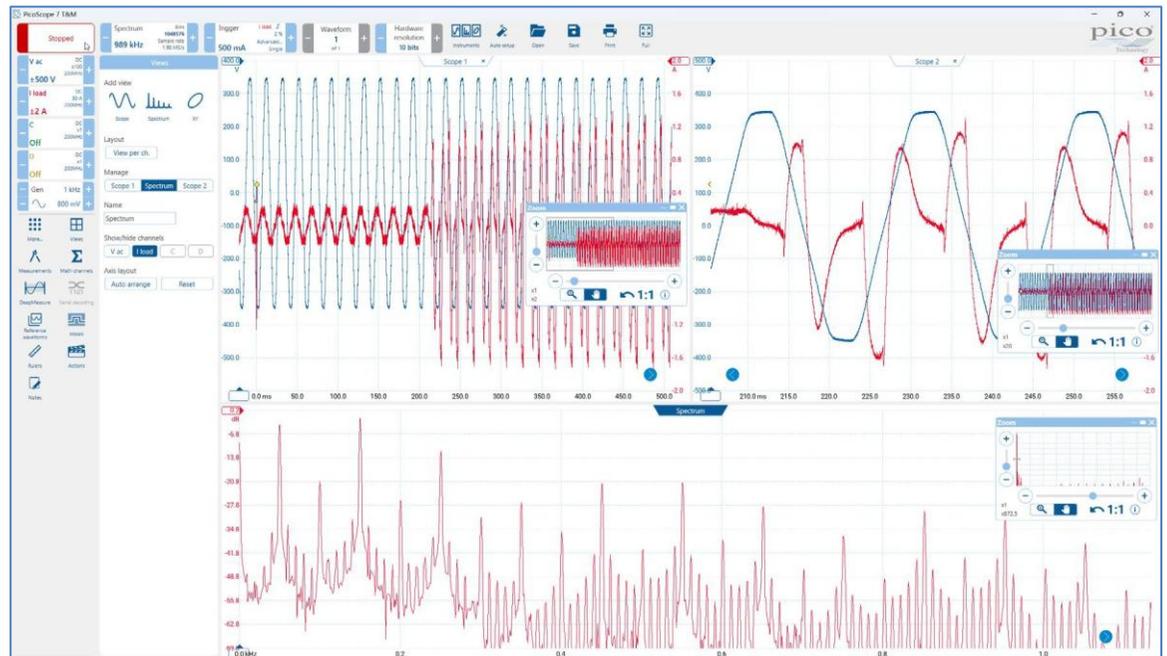

誘導負荷パワーアップシーケンス

## アクション

PicoScopeは、特定のイベントが発生したときにアクションを実行するようプログラムすることができます。

アクションをトリガーできるイベントには、測定、マスクリミット失敗、トリガーイベント、フルバッファなどがあります。PicoScopeが実行できるアクションには、以下が含まれます：

- 測定停止
- .csv、.png、.matlabなど、お好みの形式で波形をディスクに保存
- サウンドの再生
- 信号ジェネレーターまたはAWGのトリガー
- 外付けアプリケーションまたはスクリプトの実行
- ディスク上のファイルにシリアルデコードデータをエクスポート

アクションをマスクリミット試験と併用することで、時間を節約する強力な波形監視ツールとして使用することができます。既知の安定した信号をキャプチャします。その周辺でマスクを自動生成してアクションを使用し、仕様から外れる波形すべて(タイム/日付スタンプ付き)を自動で保存するようにします。



アクションの選択




イベントの選択

## ハードウェアアクセラレーションエンジン(HAL4)

大容量メモリを有効にすると、問題が生じるオシロスコープもあります。スクリーンの更新レートが遅くなったり、コントロールの反応が悪くなったりするのです。PicoScope 3000Eは、オシロスコープに内蔵された専用の第四世代ハードウェアアクセラレーション(HAL4)エンジンを使用して、このような状況を発生させません。

この大規模並列設計により、PC画面上に波形画像を効果的に表示し、連続捕捉を実行して最大毎秒20億サンプルを表示することができます。


ハードウェアアクセラレーションエンジンにより、USB接続やPCプロセッサ性能が障害になるという懸念を排除することができます。

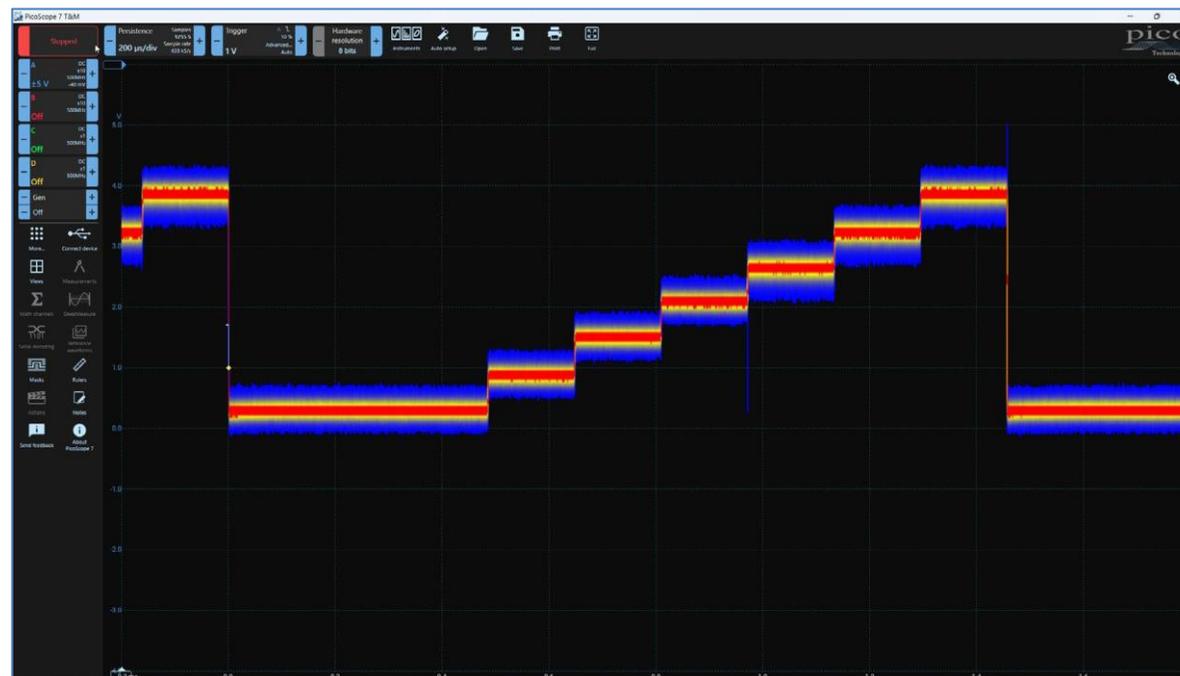

## タイムスタンプ

PicoScope 3000Eシリーズは、ハードウェアベースのトリガータイムスタンプが特徴となっています。各波形には、前の波形からのサンプル間隔における時間がタイムスタンプとして付加されます。高速トリガーリアーム時間は、700 ns(代表値)まで可能です。



トリガータイムスタンプのコントロールは、波形ナビゲーターの設定パネルにあります（画面上部の波形をクリックまたはタップします）。

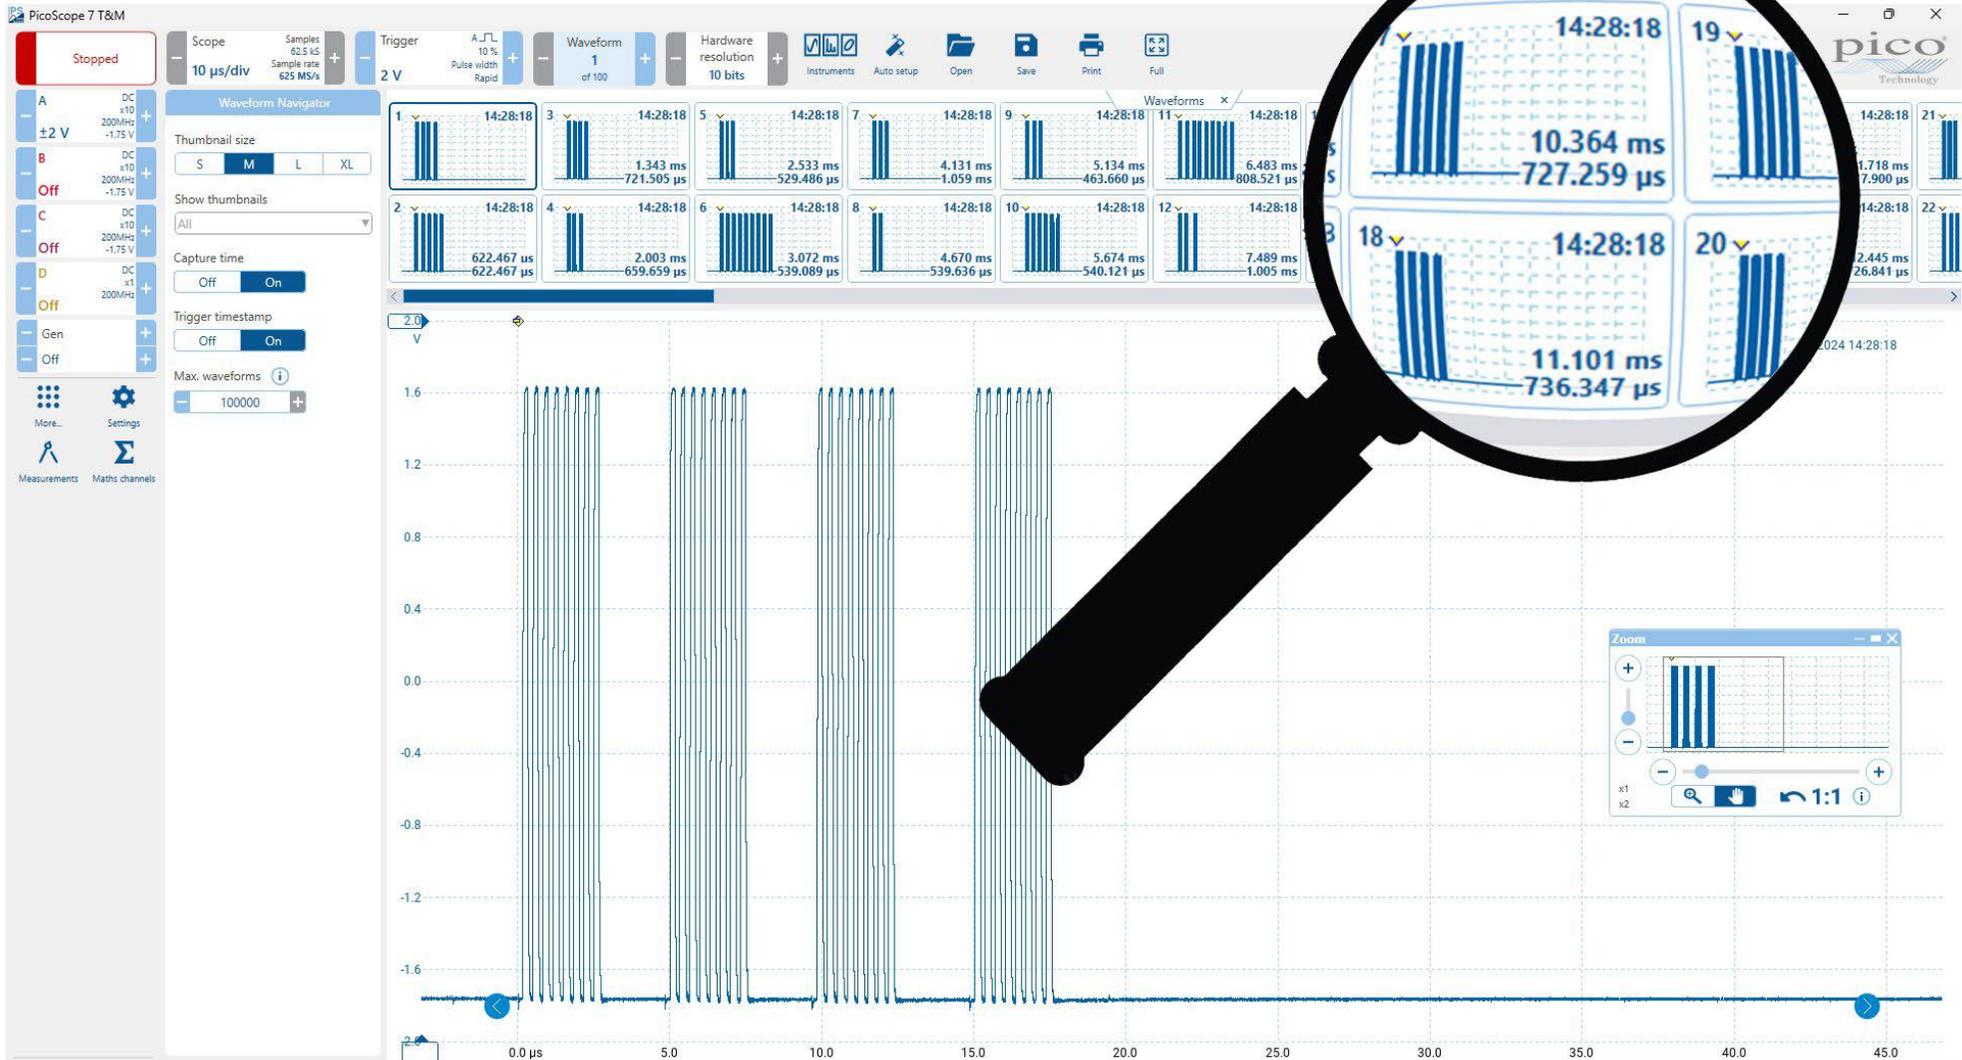

## 演算チャンネルおよびフィルター

PicoScopeの演算チャンネルは、競合他社製品を圧倒しています。加算、反転などの簡単な関数を選択するか、または方程式エディターを開いて、フィルター（ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドストップフィルター）、三角法、指数関数、対数、統計、積分、導関数が関係するような複雑な関数を作成できます。

各スコープビューには、最大8つの実際のチャンネルまたは算出されたチャンネルが表示されます。スペースがなくなったら、別のスコープビューを開いて追加できます。演算チャンネルを使って、複雑な信号の詳細を表示することも可能です。例えば、一定期間における信号のデューティサイクルや周波数の変化をグラフで表せます。

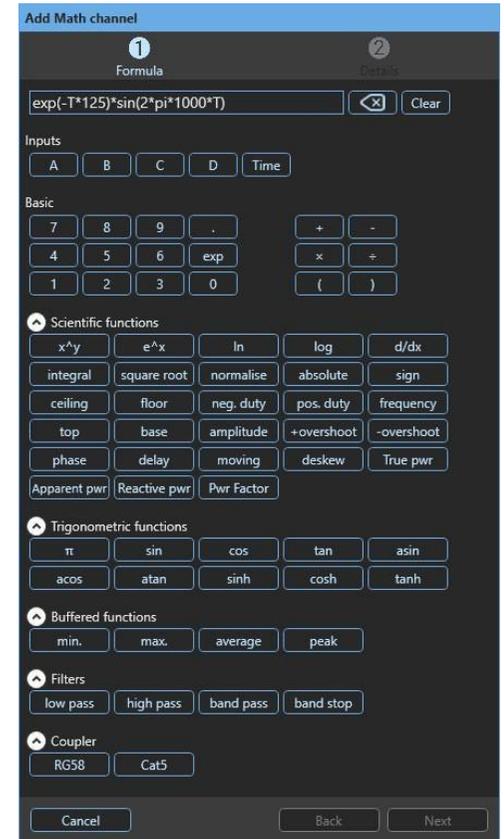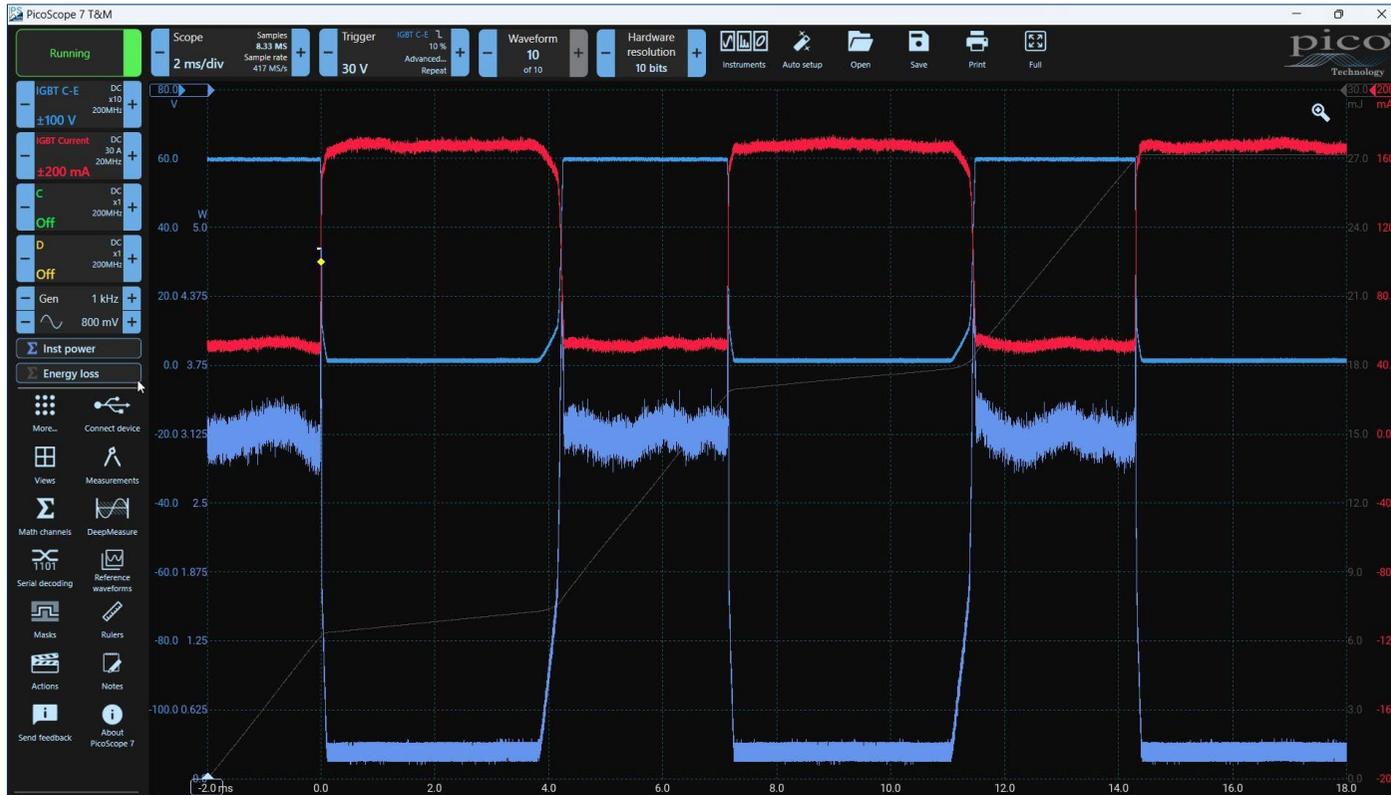

## PicoScopeオシロスコープソフトウェアのカスタムプローブ

カスタムプローブ機能により、オシロスコープに接続したプローブ、センサー、トランスデューサーなどのゲイン、減衰、オフセット、非線形性を修正できます。また、現在のプローブの出力を測定して、正しくアンペアが表示されるようにすることもできます。テーブルルックアップ機能を使って、非線形温度センサーの出力を測定するなど、より高度な使用方法も可能です。

PicoScopeに同梱の標準オシロスコーププローブおよび電流クランプの設定は含まれています。後で使用するため、ユーザーが作成したプローブを保存することも可能です。

## 超高解像度ディスプレイ

PicoScope PCベース装置は、ホストコンピューターのディスプレイを使用します。PCのディスプレイは、従来のベンチトップオシロスコープに設置されている専用ディスプレイよりサイズが大きく、解像度も高いのが普通です。これにより、時間領域波形および周波数領域波形、デコードしたシリアルバスの表、統計などを含む測定結果などを同時に表示することができます。

PicoScopeソフトウェアは、より大きなディスプレイの高解像度を最大限に活かすことができるよう、自動で調整を行います。4K超高解像度モデルにも対応しています。解像度3840 x 2160(800万ピクセル以上)を誇るPicoScopeにより、エンジニアは試験中の装置からの複数チャンネル(または同じチャンネルの異なるビュー)を画面分割ビューに表示して、より短い時間でより多くの作業を実行することができます。例に示すように、ソフトウェアは複数のオシロスコープおよびスペクトラムアナライザーのトレースを一度に表示することも可能です。

この高解像度ディスプレイが本領を発揮するのは、PicoScope 3000Eシリーズの高分解能信号を表示する場合でしょう。4Kモニターを使用すると、PicoScopeは従来のスコープの10倍以上の情報を表示することができるため、大ディスプレイと省スペースポータブルオシロスコープの機能を適合させるという問題を解決することができます。

PicoScopeは、デュアルモニターにも対応しています。装置コントロールと波形を1つ目のモニターに表示し、シリアルプロトコルデコーダやDeepMeasureの結果のより大きなデータを2つ目のモニターに表示する、ということも可能です。ソフトウェアは、マウスやタッチスクリーンで操作することができます。




## チャンネルのビューオプション

「チャンネル毎に表示」を使用すると、各チャンネル毎にフル分解能でそれぞれビューウィンドウが作成されます。

複数のチャンネルがアクティブである場合、ビューメニュー「チャンネル毎に表示」の順に選択します。


各チャンネルはそのチャンネルのビューに表示され、各スコープタブを好きな位置にドラッグして、必要に合わせてディスプレイを再配置することができます。各チャンネルビューにグリッドを表示したり、縦または横に、あるいはその組み合わせでチャンネルを表示したりできます。

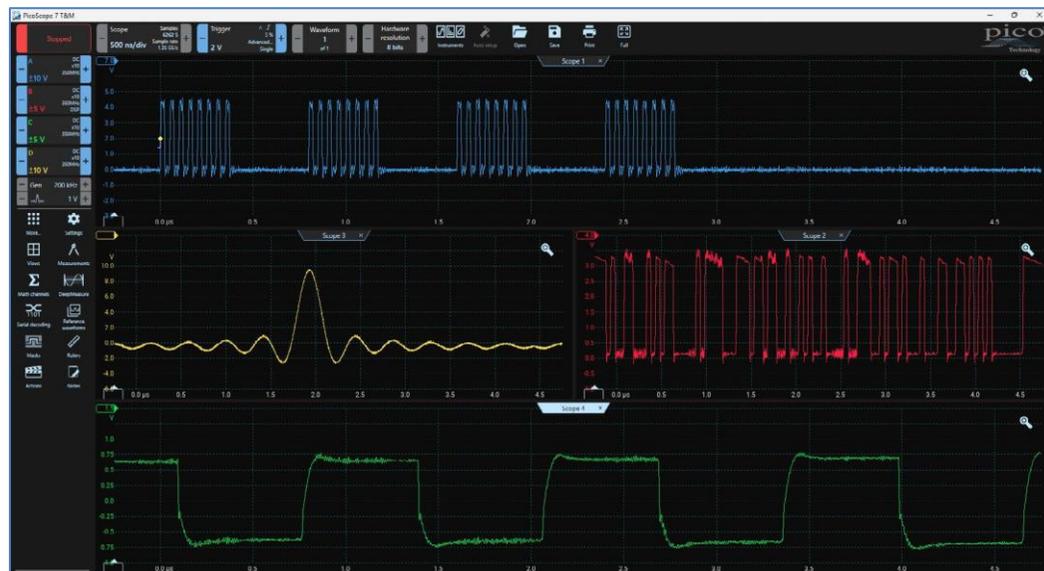

## 波形注釈


波形注釈ツールにより、設計・試験エンジニアは複雑な試験シナリオを管理できます。複数のチャンネルや関心イベントを表示したり、プロジェクトチームに共有したりできます。主要な波形イベントのライブプレゼンテーションやドキュメンテーションにより、回路動作に関する理解を深め、開発プロセスを加速することができます。

このツールにより、波形ビューにテキストボックスを自由に追加して編集したり、固定ピンポイント矢印をデータ内の特定のイベントや異常にドラッグしたりできます。それらのイベントに注意を喚起したり、状態を説明したりするのに便利です。加えて、これらの注釈を印刷時や画像のエクスポート時に表示したり、.psdataファイルに保存したりできるため、共有や配布が簡単に行えます。

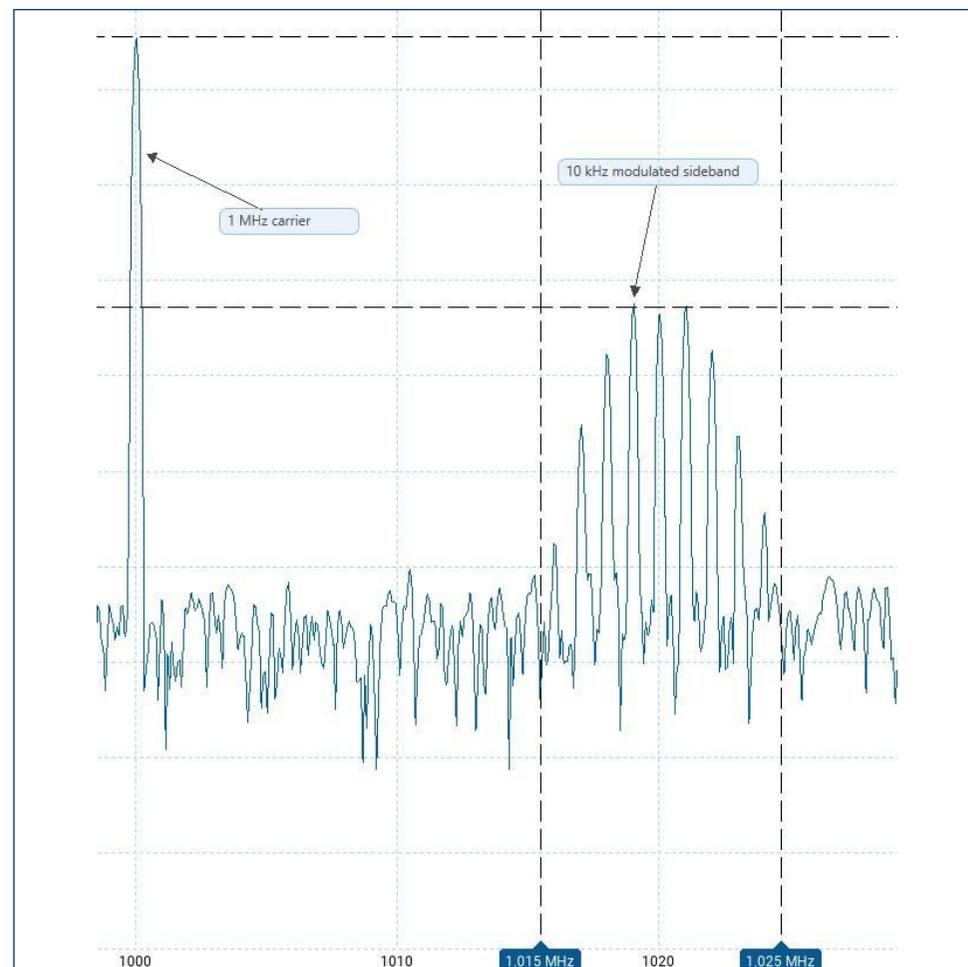

## キーボードショートカット

PicoScopeは、マウスやタッチスクリーンの操作への依存を減らし、スピードと使いやすさを向上させるための非常に包括的なキーボードショートカットセットを提供します。

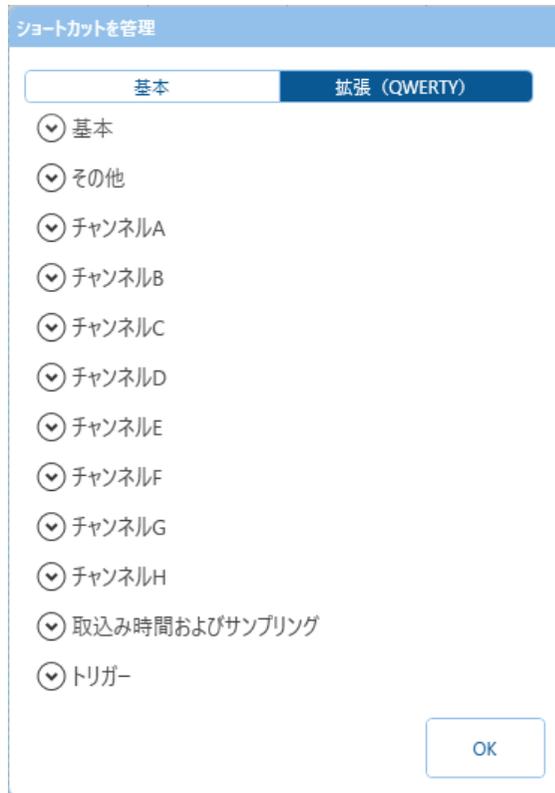

## コマンドラインインターフェース(CLI)からPicoScopeファイルを変換

PicoScopeは、Windows、macOS、またはLinuxのコマンドラインから、入力フォルダー内のPicoScopeデータファイル(.psdata)を出力フォルダー内のCSV、テキスト、またはMATLABファイルに変換できます。これにより、保存したPicoScopeファイルを他の形式に一括変換し、外部プログラムでさらに解析したり処理したりすることが可能になります。

```
Command Prompt
c:\>"C:\Program Files\Pico Technology\PicoScope 7 T&M Early Access\PicoScope.exe" BatchConvert "C:\psdata" "C:\csv" .csv
c:\>
Converting 3 files.
Converting 1/3 - 20250311_SFDR.psdata...SUCCESS.
Converting 2/3 - PS3418E-MSO-spectrum.psdata...|
```

## 数えきれないオプションを提供する強力なツール


PicoScopeには、波形の取込み・解析に役立つ強力なツールがたくさん付属しています。これらのツールを単独で使用することもできますが、併用することでPicoScopeの性能を最大限に引き出すことができます。

例えば、高速トリガモードでは、ほんの数ミリ秒で40,000波形を収集することができます。ロス時間もほとんどありません。これらの波形を手動で探すのは非常に時間がかかります。波形を1つ選んで、マスクツールを使いスキャンしてみましょう。終了すると、測定結果から失敗数を知ることができます。波形ナビゲーターにより、適切な波形を非表示にして問題のある波形のみを表示することができます。または、測定を追加して上限と下限を設定し、波形ナビゲーター内でフィルタリングし、設定したリミットに合格した、または不合格した波形を特定して表示できます。

下のスクリーンショットは、チャンネルAの信号の周波数の時間に対する変化をグラフに表したものです。

デューティサイクルの変化をグラフにするのは如何でしょうか？トリガ条件が満たされた場合、AWGからの波形を出力してディスクに波形を自動保存するのはどうでしょうか？PicoScopeをお使いいただければ、その可能性は無限に広がります。

PicoScopeソフトウェアの機能に関する詳細は、オンラインで「[Knowledge Bases\(ナレッジベース\)](#)」をご覧ください。

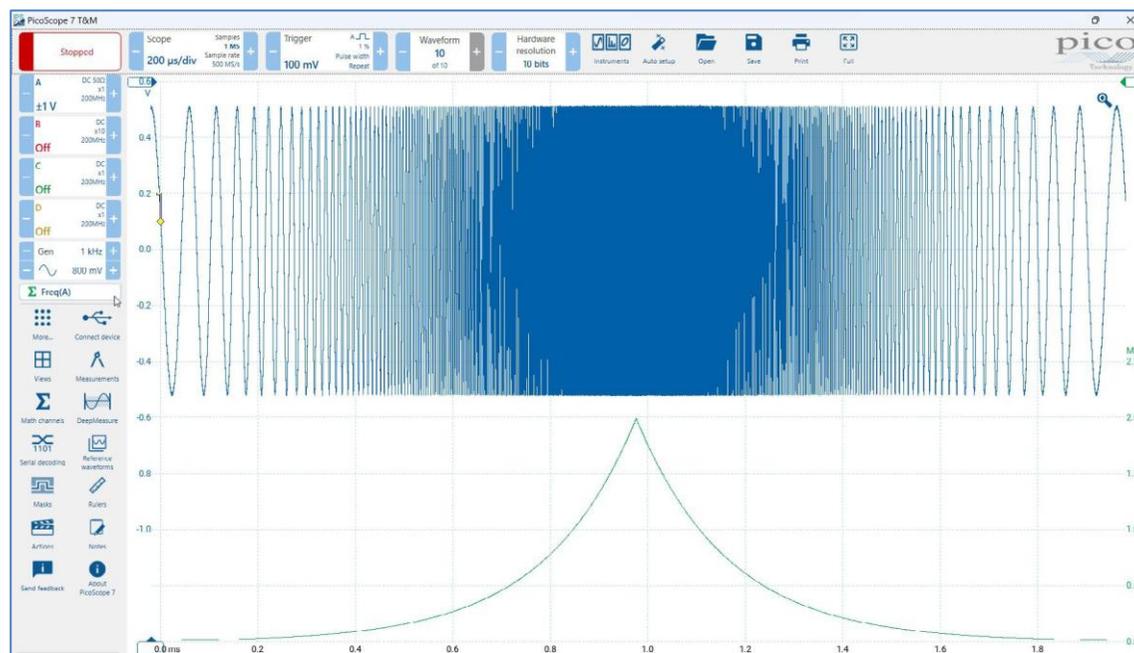

## 様々な高機能が標準装備

PicoScopeは、オプションを付けると価格が高額になる他社のオシロスコープとは異なります。当社のスコープには、シリアルデコード、マスクリミット試験、高度な演算チャンネル、セグメント化メモリ、ハードウェアベースのタイムスタンプ、信号発生器などの高度な機能がすべて標準搭載されています。

投資が無駄にならないように、PCソフトウェアやスコープのファームウェアは更新していくことができます。Pico Technologyはこれまで長い間、ソフトウェアのダウンロードにより新しい機能を無料で提供させていただいてきました。当社は、毎年機能を拡張していくことをお約束させていただいております。当社製品のお客様には、生涯当社製品をお使いいただく方が多く、同僚の皆様などにも当社製品をお勧めさせていただいております。

# PicoScope 7ソフトウェア - 時間ドメインビュー

**実行中/停止の制御:** クリックすると、波形の表示を開始します。再びクリックすると停止します。キーボードのスペースにも同じ機能があります。

## チャンネルコントロール:

各チャンネルは、PicoScope入力コネクタの1つに対応します。コントロールを使って、DUTを測定する前に、プローブの種類、チャンネル名の割り当て、垂直スケール、オフセット、入力カップリング、および他の条件パラメータの設定を行います。

## 帯域幅(BW)リミット:

利用できるBWリミットオプションは、選択した電圧範囲および分解能によって異なります。自動モードでは、設定に基づいて利用可能な最大のBWを選択します。使用中のBWリミットは、各チャンネルコントロールに表示されます。

## シリアルプロトコルデコード:

使用中のシリアルデコーダーがここにリスト表示されます。

## 自動測定:

算出した測定を表示して、トラブルシューティングや解析を行います。各ビューには、測定に必要な数だけ追加できます。各測定には、その変動を示す統計パラメータが含まれます。

## DeepMeasure:

トリガーされた各波形取得において、最大100万波形サイクルの重要な波形パラメータを自動で測定します。

## 参照波形:

波形は保存・表示して、ライブデータと比較することができます。

## ルーラー:

十字線マークを数える必要がなく、画面上で波形測定を行うのに役立ちます。


## 時間ベースのサンプリングコントロール:

秒/ディビジョン制御を使用して取得のタイミングを設定します。サンプリングコントロールにより、タイムベースの操作モードを選択できます: バッファメモリ優先度によりサンプルレートを調整し、固定したキャプチャメモリ長を維持します。サンプルレート優先度によりメモリ長を調整し、固定したサンプルレートを維持します。

## トリガーコントロール:

メインコントロールおよび高度なトリガーへのクイックアクセス。

**波形バッファナビゲーター:** PicoScopeは、環状波形バッファ内に最後の 40,000オシロスコープ波形またはスペクトラム波形を保存することができます。バッファナビゲーターにより、波形を効率的にナビゲートして検索できます。

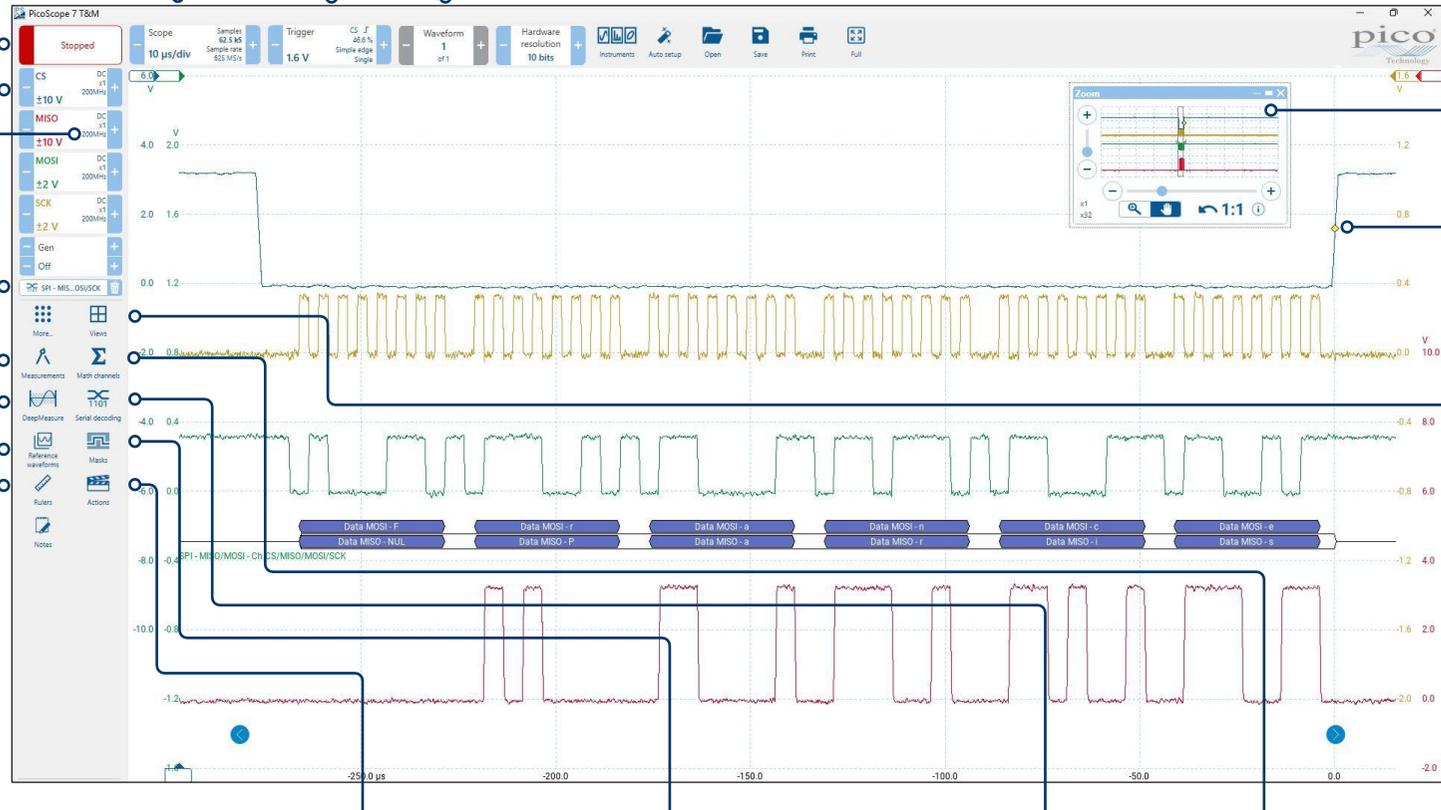

**ズーム:** ズームインで拡大したり、クリックやドラッグで周辺のパンを実行します。

**トリガーマーカー:** チャンネル、信号レベル、トリガーイベントの時間を表示します。ドラッグして調整します。

**ビュー:** 別個のスコープ、スペクトル、XYビューが表示されます。別の画面に移動することも可能です。

## アクション:

特定のイベントが発生したときに、実行するようPicoScopeをプログラムすることができます。アクションには以下が含まれます: 測定停止、波形の保存、サウンドの再生、信号ジェネレータのトリガー、アプリケーションの実行。

## マスク:

マスクリミット試験では、ライブ信号と既知の安定した信号を比較することができます。製造およびデバッグ環境で使用するために設計されています。既知の安定した信号をキャプチャし、その周辺にマスクを描画し、試験中の装置を監視します。

## シリアルデコード:

PicoScopeには、標準として40のシリアルプロトコルデコーダーが内蔵されており、追加料金はかかりません。

## 演算チャンネル:

高度な科学、三角法、バッファ、フィルター、カップラー関数や、基本的な演算。

# PicoScope 7 ソフトウェア - 周波数ドメイン(スペクトラムアナライザ)ビュー

## スペクトルコントロール:

周波数範囲、窓関数(ブラックマン、ガウス、三角、ハミング、グハン、ブラックマン、リア、フラットトップ)または矩形ピッチ、ビン幅および収集時間が計算され表示されるXY軸設定を設定します。

## トリガーコントロール:

スペクトルモードでは、スコープの高度なトリガー機能をすべて使用して、単一のイベントの周波数スペクトルを測定することができます。

## 機器:

以下のモードを切り換えます: スコープ、スペクトル、XY、パーシスタンス。

## 自動設定:

ここを最初にクリックして信号を探し、他のコントロールで調整します。

## 周波数ルーラー:

左から右ルーラーをドラッグして、軸上のポイントに印を付けます。ルーラー凡例には、各ルーラーの周波数およびそれらの差が表示されます。

## dB/電圧ルーラー:

上下にドラッグして、軸上のポイントに印を付けます。ルーラー凡例には、各ルーラーのデシベル/電圧値およびそれらの差が表示されます。

## 信号発生器:

内蔵の任意波形発生器(AWG)付きのオシロスコープ用です。標準信号、または任意波形を生成します。周波数掃引モードが含まれます。

## その他:

クリックして使用可能なツールをすべて表示し、選択したり、素早くアクセスできるようにお気に入りに入れたいことができます。

お気に入りツールや機能(測定、演算チャンネル、シリアルプロトコルデコード、ルーラー、参照波形、マスク、注釈、アクション)は、カスタムUIパネルからワンタッチでアクセスできます。

## チャンネル軸:

各チャンネルには色分けされた軸があります。上下にドラッグして、チャンネルを配置します。波形同士が重なっている場合、選択またはドラッグすると、関連する波形が前面に表示されます。マウスのスクロールホイールを使って、縮尺を調整することも可能です。

## 測定値統計:

各測定の最小、最大、平均、標準偏差が計算・表示されます。

## 測定ウィンドウ:

動的に更新した自動測定。時間ドメインや周波数ドメインの様々な測定タイプから選択できます。測定ウィンドウは、メインウィンドウから切り離すことができ、別のモニターに移動することも可能です。

## ズームウィンドウ:

アクティブなチャンネルすべての波形全体が表示されます。グレーの長方形は、現在のビューで表示されているエリアを示しています。

## ルーラー凡例:


ビューに配置したルーラー全ての位置を表示します。ビューにルーラーを配置すると自動で表示されます。

## ルーラーのロック:

1つのチャンネルに2つのルーラーが配置されている場合、凡例内のそのルーラーの隣に開いた南京錠ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、2つのルーラーがロックされ互いに追跡し合うようになります。1つをドラッグすると、もう1つのルーラーが固定された間隔を維持しつつ追跡します。ルーラーがロックされると、ボタンは「ロックされた南京錠」に変わります。

## 波形を移動:

ズームインする場合、クリックして周波数範囲を上下にパンします。

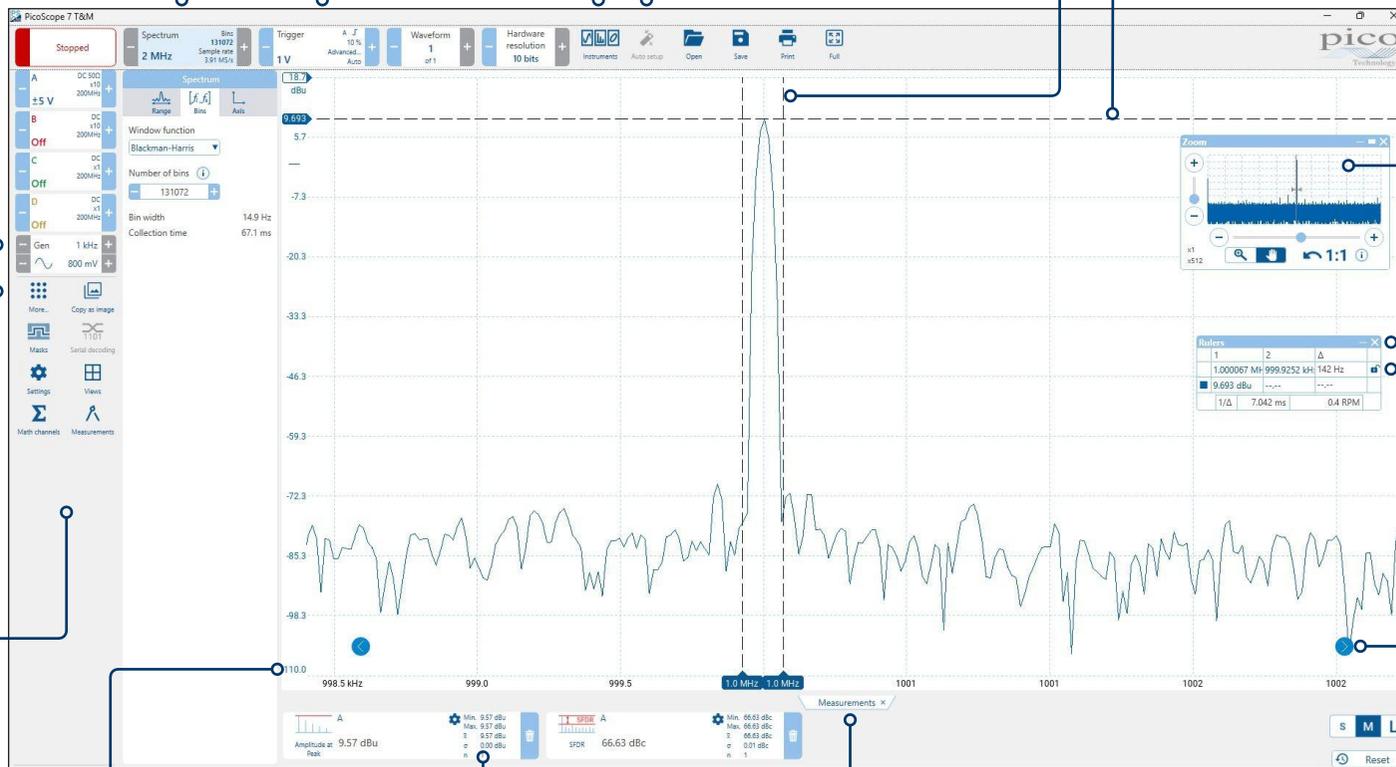

# PicoScope 7ソフトウェア:ミックスドシグナル(MSO)モデル

## 拡張デジタルトリガー:

デジタル入力の状態と、1つのデジタル入力上の推移(エッジ)の組み合わせでトリガーを行います。

## パケットサマリ:

パケットデータにマウスをかざすか、タッチし続けると、サマリが表示されます。

## ルーラー凡例:

絶対および差動ルーラー測定がここにリストされます。

## ルーラー:

アナログおよびデジタル波形の両方に表示されるため、信号のタイミングを比較できます。

## デジタルチャンネルコントロール:

デジタル信号をロジック高またはロジック低として表示します。そのチャンネルの電圧が設定したしきい値より大きい小さいかによって決まります。

デジタルチャンネルのオン・オフの切り換え、ラベルやチャンネル名の追加・編集、チャンネルの反転、色の変更、しきい値電圧の設定、波形表示サイズを選択、デジタルグループの作成などが行えます。

## シリアルプロトコルデコード:

現在使用中のシリアルデコーダーがここにリスト表示されます。各デコーダーの構成や表示オプションを編集できます。例えば、以下のデコードデータの形式を選択できます:16進法、2進法、10進法、ASCII。

## デジタルチャンネルグループコントロール:

グループに追加されたチャンネルは、リストの上部に最も重要なビットとして表示されます。

## シリアルデコード:

デコードを開始するには、ツールメニューから[シリアルデコード]を選択します。PicoScopeには、標準として40のシリアルプロトコルデコーダーが内蔵されており(さらに開発中)、追加料金はかかりません。I2CまたはCANバスなどのシリアルバスからのデータのデコードにPicoScopeを使用できます。従来のバスアナライザーとは異なり、PicoScopeでは、アナログチャンネル上に高分解能の電気波形をデータを同時に表示できます。データは、色分けされたパケットと共にスコープビューに統合されます。

## デジタルチャンネルトレース:

画面上で別個に、またはグループで調整し、測定した信号間の関係を最適化して表示できます。

## 表:

デコードデータを英数字形式で表に表示します。高度な検索やフィルター機能もあります。いずれかのフィールドでデータをソートし、表の行をダブルクリックすると、スコープビューで対応するフレームが強調されます。

## アナログ波形:

デジタル波形と同じ時間軸に描画されます。アナログであれデジタルであれ、波形を上下にドラッグして、互いに近接する関連信号を表示できます。


## グラフ:

データパケットがアナログ波形と同じ時間軸上にロジカルアナライザースタイルで表示されます。デコードデータをクリックして、スコープビューの上下にドラッグします。

表が表示されている場合、パケットをダブルクリックすると、強調表示されます。

## デジタルグループ:

ビットをフィールドにグループ化し、オプションでアナログレベルとして表示します。16進法、2進法、10進法、符号付きから表示形式を選択します。

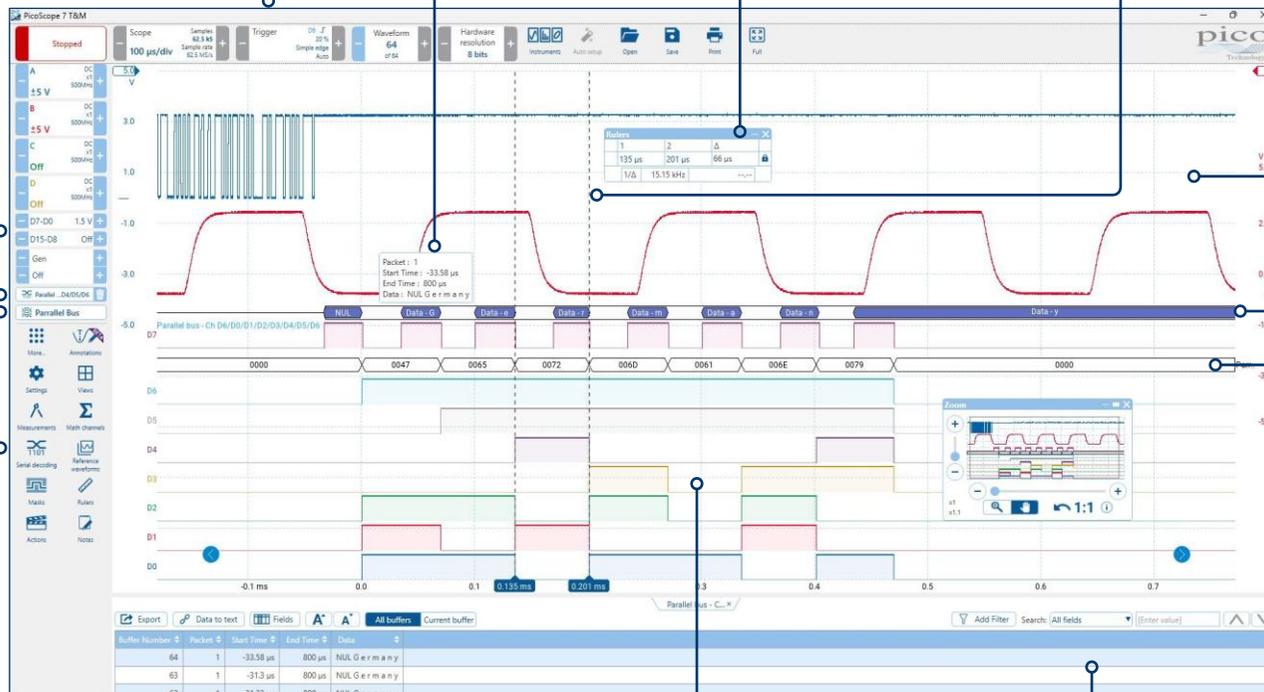


## PicoSDK - 自分のアプリを作成

当社の無償ソフトウェア開発キットであるPicoSDKを使えば、自分のソフトウェアを作成することができます。キットには、Windows、macOS、Linux用のドライバが含まれています。当社の [GitHub](#) 組織ページで提供されるコード例は、National Instruments LabVIEWやMathWorks MATLABなどのサードパーティ社製ソフトウェアパッケージ、およびC/C++、C#、Pythonなどのプログラミング言語とインターフェースで接続する方法を示しています。

ドライバは、ギャップフリーの連続データを最大300 MS/sの速度で直接 PCやホストコンピュータに取り込むモードであるデータストリーミングをサポートしているため、スコープの取得メモリのサイズに制限されることはありません。ストリーミングモードのサンプリング速度は、PCの仕様およびアプリケーションの読み込みによって異なります。

また、当社の試験&測定フォーラムやウェブサイトのPicoAppsセクションでは、PicoScopeユーザーがコードやアプリケーションを共有しています。ここに示されている周波数応答アナライザは、フォーラムで人気の高いアプリケーションです。

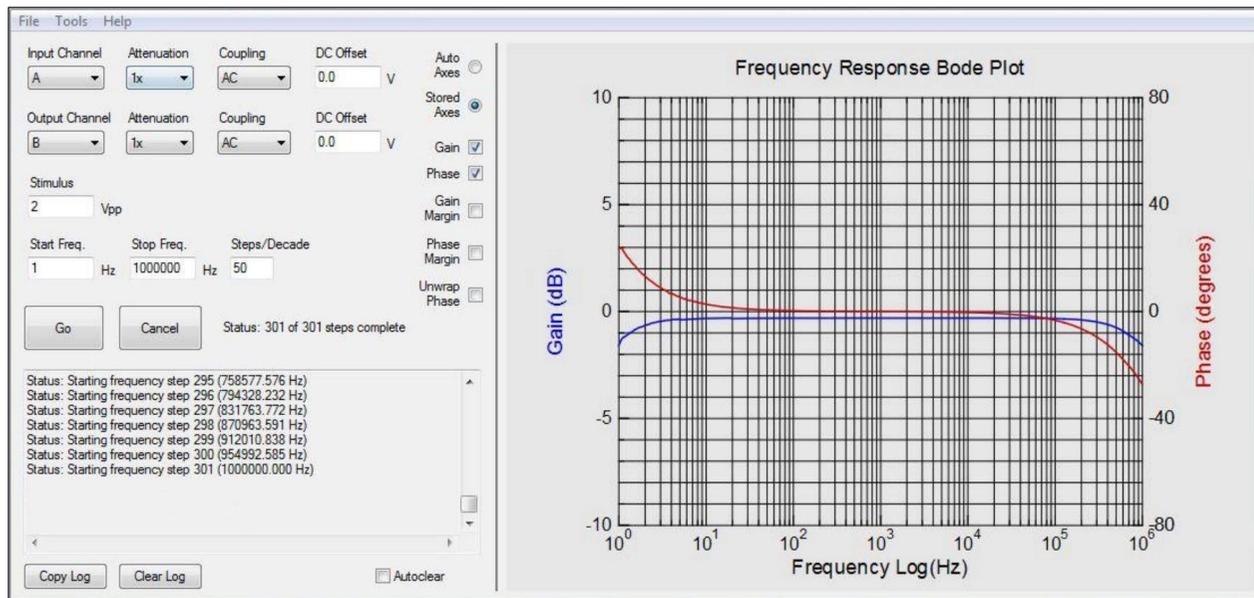

```
ScopeSettingsPropTree.clear();
wstring appVersionStringW = wstring_convert<codecvt_utf8<wchar_t>>().from_bytes(appVersionString);
ScopeSettingsPropTree.put( L"appVersion", appVersionStringW );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.inputChannel.name", L"A" );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.inputChannel.attenuation", ATTEN_1X );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.inputChannel.coupling", PS_AC );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.inputChannel.dcOffset", L"0.0" );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.inputChannel.startingRange", -1 ); // Base on stimulus
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.outputChannel.name", L"B" );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.outputChannel.attenuation", ATTEN_1X );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.outputChannel.coupling", PS_AC );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.outputChannel.dcOffset", L"0.0" );
ScopeSettingsPropTree.put( L"picoScope.outputChannel.startingRange", pScope->GetMinRange(PS_AC) );

midSigGenVpp = floor((pScope->GetMinFuncGenVpp() + pScope->GetMaxFuncGenVpp()) / 2.0);

stimulusVppSS << fixed << setprecision(1) << midSigGenVpp;
maxStimulusVppSS << fixed << setprecision(1) << pScope->GetMaxFuncGenVpp();
startFreqSS << fixed << setprecision(1) << (max(1.0, pScope->GetMinFuncGenFreq())); // Make frequency at least 1.0 since 0.0 (DC) makes no sense for FRA
stopFreqSS << fixed << setprecision(1) << (pScope->GetMaxFuncGenFreq());
```

著作権 © 2014-2024 Aaron Hexamer. GNU GPL3で配布。

## PicoLog 6ソフトウェア

PicoScope 3000Eシリーズオシロスコープは、PicoLog 6データロギングソフトウェアでもサポートされます。これにより、1度のキャプチャの信号を複数の単位で表示・記録することができます。

PicoLog 6により、チャンネルごとに最大1 KS/秒のサンプルレートが可能となるため、複数のチャンネルの電圧、電流レベルなど、一般パラメータを同時に長時間観察する際に最適です。一方で、PicoScopeソフトウェアは、波形および高調解析に適しています。

PicoLog 6を使うと、オシロスコープからのデータをデータロガーや他のデバイスからのデータと並べて表示できます。たとえば、PicoScopeで電圧や電流を測定したり、IC-08熱電対データロガーを使って対温度で両方をプロットしたりできます。

## PicoLog Cloud

お使いのPicoScopeまたはデータロガーは、ローカルディスクに測定を保存できるほか、安全なオンラインCloudストアに直接ストリーミングできます。この機能は無料でお使いいただけます。

この機能は、シンプルなユーザーインターフェースのデータロギングアプリケーションを作成するという当社のビジョンに沿ったものであり、技術系ユーザー様でも非技術系ユーザー様でも簡単に使用していただくことができます。

PicoLog Cloud(PicoLog 6にビルトイン)は、リアルタイムキャプチャデータをリモートのPicoLog Cloudスペースに直接送信したり、Cloudにビューで保存したキャプチャを保管したりする拡張機能が搭載されています。

PicoLog 6は、Windows、macOS、Linux、Raspberry Pi OSで使用することができます。



PicoLog Cloud®

## エレクトロニクスラボを持ち運ぶ

従来のベンチトップ型オシロスコープは、大変かさ張ります。

PicoScope 3000Eシリーズオシロスコープは、小型で持ち運び可能であるだけでなく、実験室または現場のエンジニアが必要とする高性能仕様を提供することができます。また、このクラスの装置としては最安値の所有コストを実現しています。

PicoScopeソフトウェアはスコープの価格に含まれており、無料でダウンロード・更新することができます。お使いのPC何台にでもインストールすることができます。スコープを使用しないオフラインでのデータの表示/分析も可能です。



出張に持っていく必要がありますか？飛行機に持ち込む必要がありますか？  
問題ありません！手荷物にも、ノートパソコンケースにも簡単に入れることができます。

# PicoScope 3000Eシリーズ仕様

PicoScope モデル:		3415Eおよび3415E MSO	3416Eおよび3416E MSO	3417Eおよび3417E MSO	3418Eおよび3418E MSO
<b>垂直(アナログチャンネル)</b>					
入力チャンネル		4			
帯域幅(-3 dB)		100MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz
立ち上がり時間 (10%~90%、-2 dBフルスケール)		1.2 ns	1.75 ns	1.2 ns	925 ps
選択可能 帯域幅制限	8ビットモード	20、50、100 MHz	20、50、100、200 MHz	20、50、100、200、350 MHz	20、50、100、200、350、500 MHz
	10ビットモード				
垂直分解能		8ビット、10ビット			
拡張垂直分解能(ソフトウェア)		ハードウェア分解能 + 4ビット			
入力コネクタ		BNC(f)			
入力特性	50 Ω	50 Ω ±2 %			
	1 MΩ	1 MΩ ±1 % // 13 pF ±2 pF			
入力カップリング	50 Ω	DC			
	1 MΩ	AC/DC			
入力感度	50 Ω	1 mV/div~1 V/div (垂直10分割)			
	1 MΩ	1 mV/div~4 V/div (垂直10分割)			
入力範囲 (フルスケール)	50 Ω	±5 mV <sup>[1]</sup> 、±10 mV <sup>[2]</sup> 、±20 mV <sup>[3]</sup> 、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、±1 V、±2 V、±5 V			
	1 MΩ	±5 mV <sup>[1]</sup> 、±10 mV <sup>[2]</sup> 、±20 mV <sup>[3]</sup> 、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V			
[1] ±5 mV(最大100 MHzまで利用可) [2] ±10 mV(最大200 MHzまで利用可) [3] ±20 mV(最大350 MHzまで利用可)					
DCゲイン精度		±(信号の1% + 1 LSB)			
DCオフセット精度		±(フルスケールの2% + 200 μV) オフセット精度は、PicoScopeのゼロオフセット機能を使用すると向上します。			
LSBサイズ (量子化ステップサイズ)	8ビットモード	入力範囲の0.4 %			
	10ビットモード	入力範囲の0.1 %			
アナログオフセット範囲 (垂直位置調整)		±250 mV(範囲±5 mV~±200 mV) ±2.5 V(範囲±500 mV~±2 V) ±5 V(範囲±5 V、50 Ω入力) ±20 V(範囲±5 V~±20 V、1 MΩ入力)			
アナログオフセットコントロール精度		オフセット設定の±1%、上記のDC精度に追加			
過電圧保護	1 MΩ	±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz			
	50 Ω	最大5.5 V RMS、ピーク最大±20 V			
<b>垂直(デジタルチャンネル)- MSOモデルのみ</b>					
入力チャンネル		16(各8チャンネルのロジカルポート2つ)			
入力コネクタ		ピッチ2.54 mm、10 x 2 方向コネクタ			
最大入力周波数		100 MHz(200 Mbit/s)			
検出可能最小パルス幅		5 ns			
しきい値のグルーピング		別個のしきい値コントロール2個。ポート0:D0 ~ D7、ポート1:D8 ~ D15			
閾値の範囲		±5 V			

PicoScope モデル:	3415Eおよび3415E MSO	3416Eおよび3416E MSO	3417Eおよび3417E MSO	3418Eおよび3418E MSO
しきい値精度	< ±350 mV(ヒステリシスを含む)			
しきい値ヒステリシス	< ±250 mV			
入力ダイナミックレンジ	±20 V			
最小入力電圧振幅	500 mV(ピークピーク値)			
入力インピーダンス	200 kΩ ± 2%    8 pF ± 2 pF			
チャンネル間スキュー	2 ns(代表値)			
最小入力スルーレート	10 V/μs			
過電圧保護	±50 V (DC + AC ピーク) 最大100 kHz			

## 水平

		8ビットモード、アナログチャンネル	8ビットモード、デジタルチャンネル <sup>[4]</sup>	10ビットモード、アナログチャンネル	10ビットモード、デジタルチャンネル <sup>[4]</sup>
最大サンプルレート (リアルタイム)	1チャンネル <sup>[5]</sup> 2チャンネル 3または4チャンネル >4チャンネル	5 GS/s 2.5 GS/s 1.25 GS/s 625 MS/s	1.25 GS/s 1.25 GS/s 1.25 GS/s 625 MS/s	2.5 GS/s 1.25 GS/s 625 MS/s 312.5 MS/s	1.25 GS/s 1.25 GS/s 625 MS/s 312.5 MS/s
最大サンプルレート、 PCメモリへの連続USBスト リーミング <sup>[6]</sup> (PicoScope 7)	1チャンネル 2チャンネル 3または4チャンネル > 4チャンネル	USB 3.0ポート ~50 MS/s ~25 MS/s ~12 MS/s ~6 MS/s	USB 2.0ポート ~10 MS/s ~5 MS/s ~2 MS/s ~1 MS/s		
最大サンプルレート、 PCメモリへの連続USBスト リーミング <sup>[6]</sup> (PicoSDK)	1チャンネル 2チャンネル 3または4チャンネル > 4チャンネル	USB 3.0ポート、8ビット分解能 ~300 MS/s ~150 MS/s ~75 MS/s ~38 MS/s	USB 3.0ポート、10ビット分解能 ~150 MS/s ~75 MS/s ~38 MS/s ~18 MS/s	USB 2.0ポート、8ビット分解能 ~30 MS/s ~15 MS/s ~8 MS/s ~4 MS/s	USB 2.0ポート、10ビット分解能 ~15 MS/s ~8 MS/s ~4 MS/s ~2 MS/s
最大サンプルレート、 ダウンサンプルデータの USBストリーミング <sup>[7]</sup> (PicoSDK)	1チャンネル 2チャンネル 3または4チャンネル > 4チャンネル	8ビット分解能 1 GS/s 500 MS/s 250 MS/s 125 MS/s	10ビット分解能 500 MS/s 250 MS/s 125 MS/s 62.5 MS/s		

[4] MSOモデルのみ

[5] チャンネルは、有効アナログチャンネルおよび/または8ビットデジタルポートの合計数です。

[6] ストリーミングモードの最大サンプルレートは、ホストコンピューターの性能や作業負荷によって異なります。

[7] ストリーミング中、ダウンサンプル(最小/最大/平均/10進法)データは、最大USBデータ帯域幅で連続してPCに返されます。ストリーミング完了後、デバイスバッファから生データを読み取ることができます。

キャプチャメモリ (チャンネルごと)	1チャンネル 2チャンネル 3または4チャンネル > 4チャンネル	8ビット分解能 2 GS 1 GS 512 MS 256 MS	10ビット分解能 1 GS 512 MS 256 MS 128 MS		
最大サンプルレートでの最大 単一取得期間	PicoScope 7	200 ms			
	PicoSDK	400 ms			
取得メモリ (連続ストリーミング)	PicoScope 7	250 MS			
	PicoSDK	装置(PC)のメモリの最大まで、キャプチャの合計時間の制限なし			



PicoScope モデル:		3415Eおよび3415E MSO	3416Eおよび3416E MSO	3417Eおよび3417E MSO	3418Eおよび3418E MSO					
波形バッファ(セグメント数)	PicoScope 7	40 000								
	PicoSDK	2 000 000								
タイムベース範囲	1 ns/div~5000 s/div									
初期タイムベース精度	±5 ppm									
タイムベースドリフト	±1 ppm/年									
ADCサンプリング	すべてのアクティブチャンネルで同時サンプリング									
<b>動的性能(代表値)</b>										
クロストーク	500:1以上(DCから影響を受けるチャンネルの帯域幅まで、同じ電圧範囲)									
高調波ひずみ (10 MHz、-2 dBfs入力)	8ビット	±50 mV~±20 V範囲で-50 dB以上								
	10ビット	±50 mV~±20 V範囲で-60 dB以上								
SFDR (10 MHz、-2 dBfs入力)	8ビット	±50 mV~±20 V範囲で 50 dB以上								
	10ビット	±50 mV~±20 V範囲で 60 dB以上								
実効値(RMS)ノイズ			周波数帯域(帯域制限)							
			レンジ	/Div	20 MHz 10ビット	50 MHz 10ビット	100 MHz 10ビット	200 MHz 10ビット	350 MHz 8ビット	500 MHz 8ビット
			±5 mV	1 mV	0.023 mV	0.036 mV	0.051 mV	該当なし	該当なし	該当なし
			±10 mV	2 mV	0.023 mV	0.036 mV	0.051 mV	0.083 mV	該当なし	該当なし
			±20 mV	4 mV	0.024 mV	0.036 mV	0.052 mV	0.10 mV	0.15 mV	該当なし
			±50 mV	10 mV	0.049 mV	0.052 mV	0.071 mV	0.13 mV	0.27 mV	0.33 mV
			±100 mV	20 mV	0.098 mV	0.098 mV	0.098 mV	0.20 mV	0.46 mV	0.63 mV
			±200 mV	40 mV	0.20 mV	0.20 mV	0.20 mV	0.37 mV	0.91 mV	1.30 mV
			±500 mV	100 mV	0.49 mV	0.54 mV	0.72 mV	1.30 mV	2.30 mV	3.40 mV
			±1 V	200 mV	0.98 mV	0.98 mV	0.98 mV	2.0 mV	4.10 mV	6.30 mV
			±2 V	400 mV	2.0 mV	2.0 mV	2.0 mV	3.70 mV	8.10 mV	12 mV
			±5 V	1 V	4.9 mV	5.5 mV	7.6 mV	14 mV	23 mV	34 mV
		±10 V	2 V	9.8 mV	9.8 mV	9.8 mV	22 mV	41 mV	63 mV	
		±20 V	4 V	20 mV	20 mV	20 mV	41 mV	81 mV	125 mV	
リニアリティ	< 2 LSB(8ビットモード) ≤ 4 LSB(10ビットモード)									
帯域フラットネス	(+0.5 dB、-3 dB) DC~全周波数帯域									
低周波フラットネス	< ±6%(または±0.5 dB)DC~1 MHz									

PicoScope モデル:	3415Eおよび3415E MSO	3416Eおよび3416E MSO	3417Eおよび3417E MSO	3418Eおよび3418E MSO
<b>トリガー</b>				
ソース	アナログチャンネル、補助I/Oトリガー MSOモデル:デジタルD0-D15			
トリガーモード	なし、自動、ノーマル、シングル、高速 (セグメント・メモリ)			
拡張トリガーの種類 (アナログチャンネル)	エッジ(立上り、立下り、立上りまたは立下り)、ウィンドウ(入る、出る、入るまたは出る)、パルス幅(正または負のパルス、またはいずれか)、ウィンドウパルス幅(時間内、ウィンドウ外またはいずれか)、レベルドロップアウト(高/低、またはいずれか)、ウィンドウドロップアウト(内、外、またはいずれか)、インターバル、ラント(正または負)、立上り/立下り時間、ロジック  ロジックトリガー機能: トリガーソース(アナログチャンネル、補助入力)のAND/OR/NAND/NOR/XOR/XNOR関数 アナログチャンネルおよび補助入力の組み合わせのユーザー定義ブール関数(PicoSDKのみ)			
トリガー感度 (アナログチャンネル)	デジタルトリガーで1 LSBの精度(最大でスコープの全帯域幅、調整可能ヒステリシス)			
拡張トリガーの種類(デジタルチャンネル)	エッジ(立がり、立下り、立上りまたは立下り)、パルス幅(正または負またはいずれか)、レベルドロップアウト(ハイ/ローまたはいずれか)、インターバル、デジタルパターン(1つのエッジに制限されたデジタル入力の状態の組み合わせ)、ロジック(ミックスドシグナル)			
プリトリガーキャプチャ	キャプチャサイズの最大100%			
ポストトリガー遅延	PicoScope 7	0 ~ > 4x10 <sup>9</sup> サンプル、1サンプルステップで設定可能 (ディレイ範囲5 GS/s、200 psステップで0.8秒)		
	PicoSDK	0 ~ > 1x10 <sup>12</sup> サンプル、1サンプルステップで設定可能 (ディレイ範囲5 GS/s、200 psステップで>200秒)		
トリガーホールドオフ(時間)	ユーザー設定時間(最大4 x 10 <sup>9</sup> サンプル間隔)で、各トリガーイベント後の作動を遅延。			
高速トリガーモードリアーム時間	最速タイムベースで< 700 ns			
最大トリガーレート (高速モード)	PicoScope 7	20 msで40 000波形		
	PicoSDK	最大メモリセグメント数までの波形数、1秒ごとに200万波形のレート。		
波形の連続更新レート	PicoScope 7高速パーシステンスモードで、1秒間に最大300,000波形			
トリガータイムスタンプ	各波形には、サンプルインターバルの分解能で前の波形からの時間のタイムスタンプが付けられます。			
<b>補助トリガー</b>				
トリガーの種類(スコープのトリガー)	エッジ、パルス幅、ドロップアウト、インターバル、ロジック			
トリガーの種類(AWGのトリガー)	立下りエッジ、立上りエッジ、ゲート高、ゲート低			
入力帯域幅	> 10 MHz			
入力特性	3.3 V CMOS Hi-Z 入力、DCカップリング			
入力しきい値	固定しきい値、低< 1 V、高> 2.3 V、3.3 V CMOSに最適			
入力ヒステリシス	最大1.3 V (V <sub>IH</sub> < 2.3 V、V <sub>IL</sub> > 1 V)			
補助出力機能	トリガー出力			
出力範囲	3.3 V CMOS (V <sub>OH</sub> > 3.2 V、V <sub>OL</sub> < 0.1 V、Hi-Zの場合)			
出力インピーダンス	約270 Ω			
出力立上り時間	BNCで直接測定:< 15 ns			
カップリング	DC			
過電圧保護	±20 V ピーク最大			
コネクタの種類	BNC(f)			
<b>ファンクションジェネレーター</b>				
標準出力信号	正弦波、方形波、三角波、DC電圧、ランプアップ、ランプダウン、sinX/X、ガウス、ハーフサイン波、ホワイトノイズ、PRBS			
出力周波数範囲	100 μHz~20 MHz			
出力周波数精度	オシロスコープのタイムベース精度 ± 出力周波数解像度			
出力周波数分解能	< 1 μHz			
掃引モード	アップ、ダウン、デュアル(選択可能な開始/停止周波数および増分)			
トリガー	フリーラン、または1~10億波形サイクル、または周波数掃引。スコープトリガー、AUXトリガーから、または手動でトリガー。			

PicoScope モデル:	3415Eおよび3415E MSO	3416Eおよび3416E MSO	3417Eおよび3417E MSO	3418Eおよび3418E MSO
ゲーティング	波形出力は、AUXトリガー入力またはソフトウェアからゲーティング(停止)できます			
疑似出力信号	ホワイトノイズ、選択可能振幅、出力電圧範囲内のオフセット PRBS(疑似ランダムバイナリシーケンス)、出力電圧範囲内で選択可能な高/低レベル、最大20 Mb/sの選択可能なビットレート			
出力電圧範囲	ハイインピーダンスで±2.0(50 Ωで±1.0 V)			
出力電圧調整	信号振幅およびオフセットは±2 Vの範囲で約0.3 mVごとに調整可能			
DC 精度	フルスケールの±1 % (ハイインピーダンス)			
振幅フラットネス	< 1.5 dB~20 MHz(代表値、50 Ωへの正弦波)			
SFDR	10 kHzのフルスケール正弦波で> 70 dB			
出力抵抗	50 Ω ±1%			
過電圧保護	±20 V ピーク最大			
コネクタの種類	BNC(f)			
<b>任意波形発生器(AWG)</b>				
更新レート	200 MS/s			
バッファサイズ	32 kS			
垂直分解能	14ビット (出力ステップサイズ約0.3 mV)			
帯域幅(-3 dB)	> 20 MHz			
立上り時間(10%~90%)	<10 ns(負荷50 Ω)			
掃引モード、トリガー、周波数精度および分解能、電圧範囲および精度、出力特性はファンクションジェネレータと同等				
<b>スペクトラムアナライザー</b>				
周波数範囲	DC~100 MHz	DC~200 MHz	DC~350 MHz	DC~500 MHz
ディスプレイモード	振幅、平均、ピークホールド			
Y 軸	対数(dbV, dBu, dBm, 任意dB)またはリニア(ボルト)			
X 軸	リニアまたは対数			
窓関数	長方形、ガウス、三角、ブラックマン、ブラックマン・ハリス、ハミング、ハン、フラットトップ			
FFTポイントの数	128~100万まで2の二乗から選択可能			
<b>演算チャンネル</b>				
関数	-x, x+y, x-y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, delay, average, frequency, derivative, integral, min, max, peak, duty, highpass, lowpass, bandpass, bandstop, coupler, top, base, amplitude, positive overshoot, negative overshoot, phase, delay, moving, deskew, true power, apparent power, reactive power, power factor, area AC, positive area AC, negative area AC, abs area AC, area DC, positive area DC, negative area DC, abs area DC			
オペランド	A~D(入力チャンネル)、D0~D15(デジタルチャンネル)、T(時間)、参照波形、pi、定数			
<b>自動測定</b>				
スコープモード	AC/DC絶対エリア、AC RMS、振幅、皮相電力、AC/DCエリア、ベース、波高率、サイクル時間、DC平均、DC電力、デューティサイクル、エッジカウント、立ち下がり時間、立ち下がりエッジカウント、立ち下がりレート、周波数、高パルス幅、低パルス幅、最大、最小、AC-エリア、DC-エリア、負のデューティサイクル、負のオーバーシュート、ピークピーク、AC+エリア、DC+エリア、正のオーバーシュート、力率、無効電力、立ち上がり時間、立ち上がりエッジカウント、立ち上がりレート、トップ、有効電力、有効RMS			
スペクトルモード	ピークの周波数、ピークの振幅、ピークの平均振幅、電力合計、THD %、THD dB、THD+N、SINAD、SNR、IMD			
統計	最小、最大、平均、標準偏差			
<b>DeepMeasure</b>				
パラメータ	サイクル数、サイクル時間、周波数、低パルス幅、高パルス幅、デューティサイクル(高)、デューティサイクル(低)、立上り時間、立下り時間、アンダーシュート、オーバーシュート、最大電圧、最小電圧、電圧ピークピーク値、開始時間、終了時間			
<b>シリアルデコード</b>				
プロトコル	10BASE-T1S, 1-Wire, ARINC 429, BroadRReach, CAN, CAN FD, CAN J1939, CAN XL, DALI, DCC, Differential Manchester, DMX512, Ethernet 10BASE-T, Extended UART, Fast Ethernet 100BASE-TX, FlexRay, I2C, I2S, I3C BASIC v1.0, LIN, Manchester, MIL-STD-1553, MODBUS ASCII, MODBUS RTU, NMEA-0183, Parallel Bus, PMBus, PS/2, PS15 (Sensor), Quadrature, RS232/UART, SBS Data, SENT Fast, SENT Slow, SENT SPC, SMBus, SPI-MISO/MOSI, SPI-SDIO, USB (1.0/1.1), Wind Sensor			

PicoScope モデル:	3415Eおよび3415E MSO	3416Eおよび3416E MSO	3417Eおよび3417E MSO	3418Eおよび3418E MSO
<b>マスクリミット試験</b>				
統計	成功/失敗、失敗カウント、合計カウント			
マスク作成	波形から自動生成、またはファイルからインポート			
<b>ディスプレイ</b>				
ディスプレイモード	スコープ、XYスコープ、パーシスタンス、スペクトル			
補間	直線またはsin(x)/x			
パーシスタンスモード	時間、頻度、高速			
出力ファイル形式	csv、mat、pdf、png、psdata、pssettings、txt			
出力機能	クリップボードにコピー、印刷			
<b>データ転送</b>				
取り込み波形のPCへのUSB転送レート	USB 3.0使用時、PCによって異なる:8ビットモード:最大360 MS/s、10ビットモード:最大180 MS/s USB 2.0使用時、PCによって異なる:8ビットモード:最大40 MS/s、10ビットモード:最大20 MS/s			
ハードウェアアクセラレータによる波形表示レート	ハードウェアアクセラレーションにより、1秒につき2 GS以上のデータを画面に表示可能(8ビットモード、4チャンネル、最大サンプルレートでチャンネル毎に250 MS)			
<b>一般仕様</b>				
PC接続性	USB 3.0 SuperSpeed (USB 2.0との互換性あり)			
PCコネクタの種類	USB 3.0 Type-C			
電力要件	USB Type-C (3A) シングルポートまたは外部Type-C PSU(5V, 3A)から電源供給			
ステータスインジケータ	BNCコネクタ、電源、ステータスをRGB LEDで表示			
温度管理	低ノイズ自動ファン速度コントロール			
寸法	221 x 173 x 30 mm			
重量	< 0.7 kg			
周囲温度範囲	操作時	0 ~ 40 °C		
	精度保証	20分のウォームアップ後15~30 °C		
	保管時	-20 ~ +60 °C		
湿度範囲	操作時	相対湿度5%~80%(結露なきこと)		
	保管時	相対湿度5%~95%(結露なきこと)		
高度	最高2000 m			
汚染度	EN 61010規定の汚染度2:「非導電性の汚染で、結露によって一時的な導電性が発生することがある」			
安全適合	EN 61010-1準拠の設計			
EMC適合	EN 61326-1およびFCCパート15サブパートBに従って試験			
環境適合	RoHS、REACH & WEEE			
保証	5年			
<b>ソフトウェア</b>				
Windowsソフトウェア(64ビット) <sup>[8]</sup>	PicoScope 7、PicoLog 6、PicoSDK( <a href="#">GitHub</a> のPico Technologyページでは、アプリを作成するユーザー向けにすべてのプラットフォームのプログラム例が提供されています)			
macOSソフトウェア(64ビット) <sup>[8]</sup>	PicoScope 7、PicoLog 6、PicoSDK			
Linuxソフトウェア(64ビット) <sup>[8]</sup>	PicoScope 7ソフトウェアおよびドライバ、PicoLog 6(ドライバを含む) ドライバのみをインストールする場合は、 <a href="#">Linuxソフトウェアおよびドライバ</a> を参照してください			
Raspberry Pi 4Bおよび5 (32ビットRaspberry Pi OS) <sup>[8]</sup>	PicoLog 6(ドライバを含む) ドライバのみをインストールする場合は、 <a href="#">Linuxソフトウェアおよびドライバ</a> を参照してください			
<sup>[8]</sup> 詳細は <a href="http://picotech.com/downloads">picotech.com/downloads</a> を参照してください。				

PicoScope モデル:		3415Eおよび3415E MSO	3416Eおよび3416E MSO	3417Eおよび3417E MSO	3418Eおよび3418E MSO
サポートされる言語	PicoScope 7	英語(米国)、英語(英国)、ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フランス語、韓国語、クロアチア語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、日本語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロベニア後、セルビア語、フィンランド語、スウェーデン語、トルコ語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)			
	PicoLog 6	中国語(簡体字)、オランダ語、英語(英国)、英語(米国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語			
PC要件		プロセッサ、メモリ、ディスク容量:OSの要件に応じて ポート:USB 3.0(推奨)または2.0(対応)			

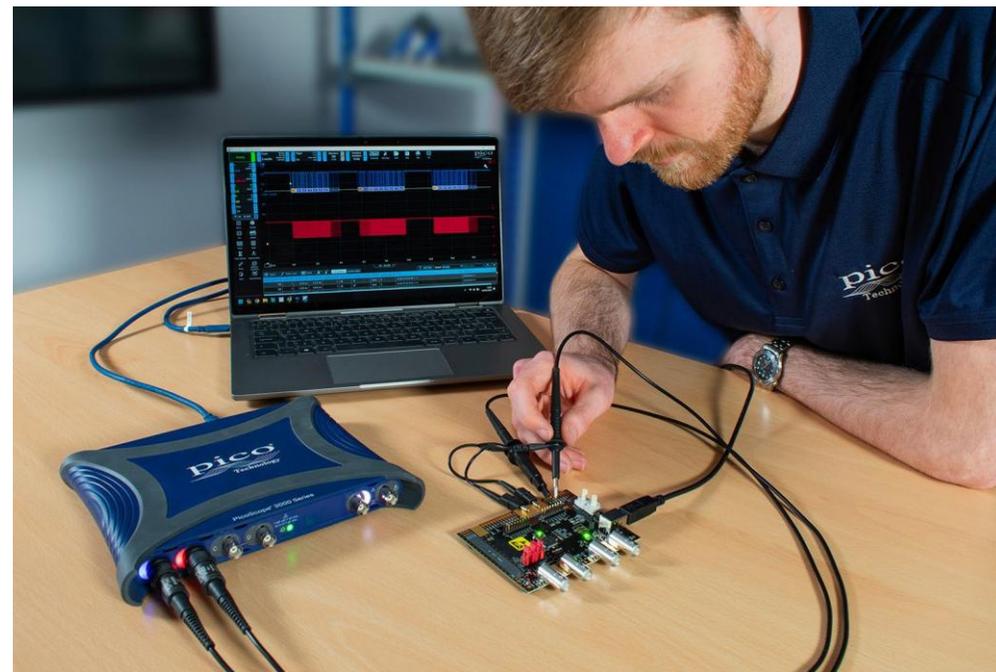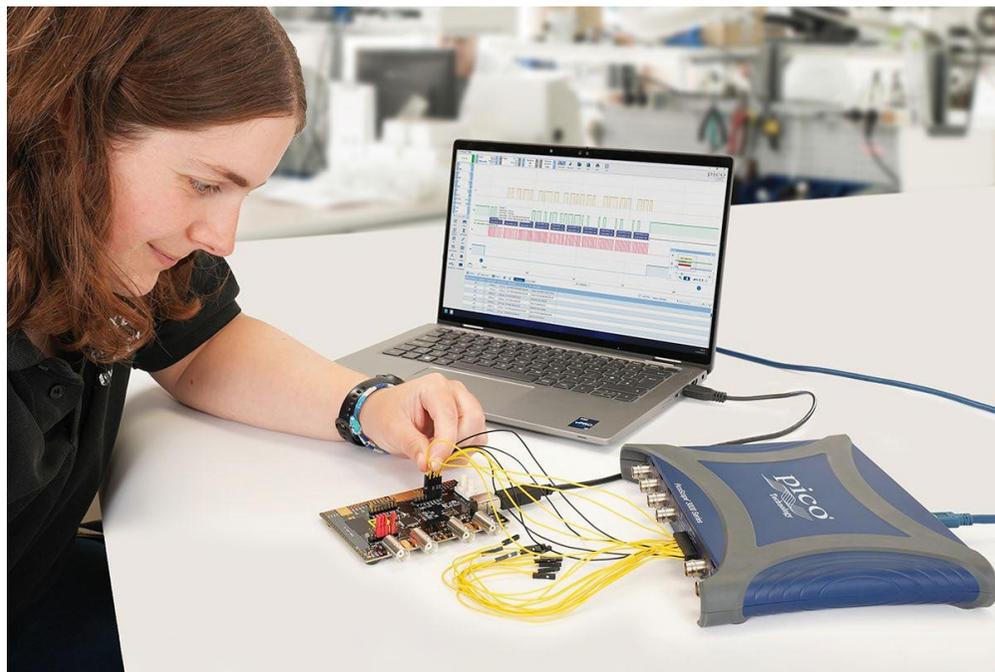

## PicoScope 3000Eシリーズオシロスコープキット同梱物<sup>[9]</sup>:

- PicoScope 3000Eシリーズオシロスコープ
- TA532 USB-C to USB-Cケーブル、1.8 m
- TA534 USB-A to USB-Cケーブル、0.9 m
- MSOケーブル、TA139 MSOクリップセット2個(MSOモデルのみ)
- PS017 USB-C電源(UK、EU、US、AUS用変換プラグ付き)
- ユーザーガイド

[9] プローブ無しの構成やOEMおよび標準以外の製品構成もご利用いただけます。  
[www.picotech.com/tech-support](http://www.picotech.com/tech-support)を参照してください

## アクセサリ(オプション、注文時に選択する場合):

- TA536、350 MHz、1:1/10:1プローブ(3417Eおよび3417E MSO)
- TA537 5 mmプローブ(BNCアダプタ用、3417Eおよび3417E MSO)
- P1053、500 MHz、10:1プローブ(3418Eおよび3418E MSO)
- TA563 3.5 mmプローブ(BNCアダプタ用、3418Eおよび3418E MSO)



PicoScope 3415E, 3416E および 3417Eキット



PicoScope 3418Eキット



PicoScope 3415E MSO, 3416E MSO および 3417E MSOキット



PicoScope 3418E MSOキット

## オプションの対応アクセサリおよび交換用アイテム:

注文コード	説明
オシロスコープのプローブ	
TA375	100 MHzプローブ(シングルパック)
TA386	200 MHzプローブ(シングルパック)
TA536	350 MHzプローブ(シングルパック)
TA561	500 MHzプローブ(シングルパック)
ケーブル	
TA532	USB Type-C to USB Type-Cケーブル、1.8 m
TA534	USB Type-A to USB Type-Cケーブル、0.9 m
MSOアクセサリ	
TA136	20方向25 cmデジタルMSOケーブル
TA139	ロジックテストクリップ12個セット
アダプター	
TA537	BNCアダプター(5 mm) TA375, TA386, TA536用
TA563	BNCアダプター(3.5mm) TA561用
電源	
PS017	5 V、3 A、UK/EU/US/AUS、USB-C電源

## 総所有コスト(TCO)、環境に対する配慮および携帯性

PicoScope 3000Eシリーズの総所有コストが、従来のベンチトップタイプの装置より低く抑えられているのには理由があります。

- シリアルプロトコルデコーダー、演算チャンネル、マスクリミット試験などすべてが購入価格に含まれます。高額なオプションのアップグレードや年間のライセンス料金は必要ありません。
- 無料の更新:製品をご使用いただく期間中ずっと、新しく開発・リリースされた機能を更新してご利用いただけます。
- PicoScope 3000Eシリーズは持ち運びしやすく、デスクスペースが限られている自宅での作業にも最適です。
- 15 W以下の低い電力消費により、節約できるだけでなく環境にも優しい仕様です。
- 5年保証。



## PicoScope 3000Eシリーズキットのご注文について:

説明	帯域幅	チャンネル	分解能(ビット)	メモリ(GS)
PicoScope 3415Eキット	100 MHz	アナログ4	8 ~ 10	2 GS(8ビットモード) 1 GS(10ビットモード)
PicoScope 3416Eキット	200 MHz			
PicoScope 3417Eキット	350 MHz			
PicoScope 3418Eキット	500 MHz			
PicoScope 3415E MSOキット	100 MHz	アナログ4 + MSO 16(デジタル)	8 ~ 10	2 GS(8ビットモード) 1 GS(10ビットモード)
PicoScope 3416E MSOキット	200 MHz			
PicoScope 3417E MSOキット	350 MHz			
PicoScope 3418E MSOキット	500 MHz			

## キャリブレーションサービス:

注文コード	説明
CC017	PicoScope 3000Eシリーズオシロスコープ(100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz)の校正証明書

## Pico Technologyのその他の製品...



**PicoLog TC-08**  
温度データロガー  
8チャンネル、20ビット分解能、  
測定: 270 °C ~ +1820 °C



**PicoScope 9400 SXRTO**  
サンプラー拡張  
リアルタイムオシロスコープ  
5 ~ 25 GHz



**PicoVNA**  
実験室でも現場でも使える、  
低コストの専門グレード性能  
6 GHz/8.5 GHzベクトルネット  
ワークアナライザー



**PicoScope 6000シリーズ**  
最大8チャンネル、  
超大容量 4 GSメモリバッファ  
、ギガビットMSOチャンネル

### 英国グローバル本社:

☎ +44 (0) 1480 396 395  
✉ [sales@picotech.com](mailto:sales@picotech.com)

Pico Technology  
James House  
Colmworth Business Park  
St. Neots  
Cambridgeshire  
PE19 8YP  
英国

### 北米支社:

☎ +1 800 591 2796  
✉ [sales@picotech.com](mailto:sales@picotech.com)

Pico Technology  
320 N Glenwood Blvd  
Tyler  
TX 75702  
米国

### ドイツ支社および EU 認定代理店:

☎ +49 (0) 5131 907 62 90  
✉ [info.de@picotech.com](mailto:info.de@picotech.com)

Pico Technology GmbH  
Emmericher Str. 60  
47533 Kleve  
ドイツ

### アジア太平洋地域支社:

☎ +86 21 2226-5152  
✉ [pico.asia-pacific@picotech.com](mailto:pico.asia-pacific@picotech.com)

本書には誤字・脱字が含まれている場合があります。Pico Technology PicoScope PicoLog、PicoSDKは、Pico Technology Ltd.の国際登録商標です。GitHubは、米国におけるGitHub, Inc.の登録商標です。LabVIEWはNational Instruments Corporationの商標です。Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。macOSは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。Windowsは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。USB Type-CおよびUSB-CはUSB Implementers Forumの登録商標です。KensingtonおよびNanoSaverはKensington Computer Products Groupの登録商標です。

MM131.ja-3 Copyright © 2024 Pico Technology Ltd. 無断複写・複製・転載禁止。



[www.picotech.com](http://www.picotech.com)

<https://picotech.jp/>